



DZP.381.46A.2021

Katowice 29.09.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

KRS: 0000049660

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa narzędzi medycznych (III) - DZP.381.46A.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 nożyczki spojówkowe delikatne, końcówki ostre, delikatnie zakrzywione, długość ostrzy do trzpienia 24 mm, długość całkowita 105mm, mechanizm krzyżowy, ramiona robocze o końcówkach pierścieniowych. Podana różnica w długości narzędzia nie wpływa na funkcjonalność narzędzia i odbiega tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 nożyczki do przecinania soczewek akrylowych oraz silikonowym IOL średnica końcówki 18G, ostrza o długości 4 mm, długość części roboczej 15 mm, ostrza wewnętrznie ząbkowane część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, rękojeść tytanowa długość całkowita 100 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 nożyczki witreoretinalne końcówki zagięte ostre typu gilotyna do systemu trokarowego 23G/ 0.6 mm część robocza ze stali nierdzewnej, rękojeść tytanowa długość całkowita 115 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 nożyczki witreoretinalne końcówki proste do systemu trokarowego 23G/0.6 mm długość części roboczej 35 mm, końcówka robocza ze stali nierdzewnej, rękojeść tytanowa długość całkowita narzędzia 115 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pęsetę witreoretinalną do systemu trokarów 23G/0.6 mm końcówka typu krokodylek, mechanizm roboczy sprężynowo dźwigniowy długość części roboczej 35 mm długość całkowita 115 mm część robocza ze stali nierdzewnej, rękojeść tytanowa

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 kasetę do sterylizacji o wymiarach 200 x 110 x 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 kasetę do sterylizacji o wymiarach 102 x 190 x 38 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 kasetę do sterylizacji o wymiarach 190 x 64 x 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 imadło Jakobi proste bardzo delikatne szczęki o długości 7 mm, część robocza 1.0 x 0.5 mm; długość całkowita 120 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem podłużnym antypoślizgowym. Podana różnica w długości narzędzia nie wpływa na funkcjonalność narzędzia i odbiega tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pęsetę do rzęs typu BEER, półokrągłe końcówki o szerokości 4,5mm, głębokość gładkiej płaskiej platformy roboczej 3mm, długość całkowita 90mm, rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. Podana różnica w długości narzędzia nie wpływa na funkcjonalność narzędzia i odbiega tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 Nożyczki do kapsułotomii typ TUEBINGEN, proste, długość ostrzy 7 mm, ostre końcówki, szerokość w osi obrotu sworznia 1,8mm, długość całkowita 85 mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym. Podana różnica w długości narzędzia nie wpływa na funkcjonalność narzędzia i odbiega tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 12:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia otrzymania reklamacji” oraz „...od chwili zgłoszenia” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



Pytanie nr 13:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy - w wysokości 0,2% kwoty brutto niezrealizowanej części zamówienia- za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia;

b) za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,2% kwoty brutto wadliwej części dostawy - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy;

c) w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w pakiecie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wystawiał i przysyłał faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adres e-mail: faktury@uck.katowice.pl pod warunkiem, iż Zamawiający również będzie mógł dokonywać powyżej wskazanych czynności na wskazany przez Wykonawcę w umowie adres e-mail.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 15: Pakiet 2: Narzędzia chirurgia

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie haka Hoesel wym. łyżki 220x30 mm, dł. całkowita 250 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16: Pakiet 2: Narzędzia chirurgia

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. cz. roboczej 130x60 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 17: Pakiet 2: Narzędzia chirurgia

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. łyżki 180x60 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 18: Pakiet 3: Narzędzia chirurgiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 19: Pakiet 3: Narzędzia chirurgiczne

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 20: Pakiet 3: Narzędzia chirurgiczne

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 21: Pakiet 5: Łyzeczka do gradówki

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki Skeeel o śr. 1 mm, lub Meyhoffer o śr. 1,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łyżeczkę Meyhoffer o śr. 1,5 mm, zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 22: Pakiet 16: Kaniule

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kaniuli Anel wykonanej ze stali, nie stożkowej o śr. 23G, dł. całkowita 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 23: Pakiet 16: Kaniule

Lp.2 Prosimy o opuszczenie kaniuli o śr. 16G, bez oliwki, dł. całkowita 35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 24: Pakiet 17: Imadło

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie imadła micro2000, prostego, dł. całkowita 120 mm, szczęki 10 mm, rękojeści z poprzecznym ryflowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 25: Pakiet 18: Rozwórka

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie rozwórki o dł. 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 26: Pakiet 20: Nożyczki do kapsułotomii

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 85 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 27: Pakiet 21: Pęseta

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie pesety o dł. 70 mm i końcówce roboczej 0,2 mm lub pesetę McPherson o dł. 85 mm bez poprzecznego żłobienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pesetę o dł. 70 mm i końcówce roboczej 0,2 mm zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 28:

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz

wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation).

Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu

Pytanie nr 29:

Pakiet 2, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 130 x 60 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 30:

Pakiet 2, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 180 x 60 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 31:

Pakiet 3, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 32:

Pakiet 3, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 33:

Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka śr. 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 34:

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 85 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 35:

Pakiet 19, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 90 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 36:

Pakiet 20, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. ostrzy 9,5 mm, dł. całkowita 82 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 37:

Pakiet 21, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta platforma o dł. 4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 2** hak miedniczy St. Marks o długości 29 cm, części roboczej 142x60 mm ?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 3** hak miedniczy St. Marks o długości 32 cm, wymiar łżyki 193x60 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 3 pozycji nr.2** uchwyt skalpela o długości 12 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 3 pozycji nr. 3** imadło chirurgiczne o długości 16 cm ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 pozycji nr. 1** pęsetę o długości całkowitej 7 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 18 pozycji nr. 1** rozwórkę Barraquer o długości całkowitej 3 cm , półokrągła 10 mm lub o długości 4 cm, półokrągła 14 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwórkę Barraquer o długości całkowitej 30 mm zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 19 pozycji nr. 1** pęsetę o długości 9 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 pozycji nr. 1** pęsetę o długości 7 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 46: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1

Prosimy o sprecyzowanie przeznaczenia i opis wymaganego narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania Haka operacyjnego typu Muller długość całkowita 270mm wielkość łyżki 250x30mm. Przeznaczenie: wykonywanie zabiegów chirurgicznych.

Pytanie nr 47: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Hak typu CORYLLOS o długości 240 mm z końcówką 115 x 65 mm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza



Pytanie nr 48: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Hak typu KÖRTE-WAGNER o długości 280 mm tępy 8-zebny z końcówką 25 x 40 mm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 49: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: hak typu KÜMMEL, o długości 285 mm, końcówka 46 mm, elastyczny?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 50: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie haka typu SENN-MUELLER, dł. 160 mm końcówki 7 x 8,5 mm i 22 x 7 mm, tępy?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 51: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Hak typu VOLKMANN dł. 200 mm końcówka 30 x 20mm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza



Pytanie nr 52: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia: Hak typu ST. MARKS dł. 330 mm końcówka 180x60 mm?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 53: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Hak typu ST. MARKS dł. 330 mm końcówka 178x60 mm?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 54: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kleszczyki typu ZENKER dł. 305 mm odgięte?



Odpowiedź:

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach $\pm 2\%$ w związku z czym długość 305 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 55: dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kleszczyki typu ZENKER dł. 310 mm odgięte?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 56: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-DELICATE 130 mm proste 1X2 ząbki?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 57: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 152 mm prosty?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 58: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 180 mm prosty?




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 59: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Igłotrzymacza typu MAYO-HEGAR dł. 160 mm prosty z twardą wkładką?




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 60: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 177 mm prosty z twardą wkładką?

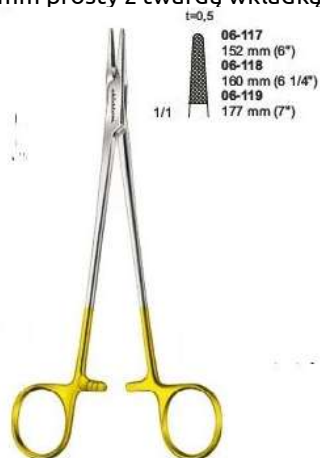

MAYO-HEGAR
ząbkowane krzyżowo
/karier/cross serrated

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 61: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR delikatny dł. 160 mm prosty?



MAYO-HEGAR

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 62: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Iglotrzymacz typu MAYO-HEGAR delikatny dł. 180 mm prosty?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 63: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Pincetę anatomiczną typu MEDIUM, dł. 160 mm, czubek 2,5 mm, prostą?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 64: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Pincetę anatomiczną typu MC INDOE, dł. 155 mm, czubek 1,3 cm, prostą?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 65: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Pincety anatomicznej delikatnej typu SEMKEN, dł. 152 mm, czubek 1,3 mm, prosta?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 66: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 130 mm proste?




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 67: dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Kleszczyki naczyniowe typu PEAN 130 mm proste?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 68: dotyczy pakietu nr 19, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Pincetę epilacyjną typu BEER, dł. 90 mm, czubek 3,8 mm, prosta?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 69:

Czy w pakiecie 5 Zamawiający dopuści łyżeczkę do gradówki MEYHOEFFER, okrągła szufelka o średnicy 1,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 70:

Czy w pakiecie 7 Zamawiający dopuści Nożyczki do przecinania wszczepianych akrylowych lub silikonowych soczewek IOL, górne ostrze długości 6mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 71:

Czy w pakiecie 8 Zamawiający dopuści Nożyczki do przecinania wszczepianych akrylowych lub silikonowych soczewek IOL: średnica trzpienia 19Ga/1,1mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 72:

Czy w pakiecie 15 Zamawiający dopuści Kasetkę do sterylizacji parowej, zamykaną na zatrzaski z matą silikonową, rozmiar 190x101x19mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 73: Dot.: Pakiet nr 15, poz.1:

Czy Zamawiający wymaga do dostawy:

Kasetka do sterylizacji parowej, zamykana na zatrzaski z matą silikonową, rozmiar 101,6x190 x 19mm

Odpowiedź:


Zamawiający niniejszym poprawia omyłkę pisarską w pakiecie 15 w zakresie wymaganych wymiarów zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 05.10.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 11.10.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 05.10.2021 r. godz. 10³⁰ na 11.10.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych