



DZP.381.25A.2022

Katowice 03.06.2022 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawę ultradźwiękowego aspiratora tkankowego - DZP.381.25A.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Dot. Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy bez ekranu dotykowego? Ustawianie parametrów ssania, irygacji i wibracji ultradźwiękowej za pomocą przycisków na osobnych polach panelu głównego. Podświetlane wartości irygacji, ssania i wibracji ultradźwiękowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 2:

Dot. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści aspirator z osobnymi uchwytami roboczymi do tkanek miękkich i kości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych jednak wymaga w tym przypadku 2 szt. uchwytów do tkanek miękkich oraz 2 szt. uchwytów do kości.

Pytanie nr 3:

Dot. Pkt. 9 i 10 Czy Zamawiający dopuści sterownik nożny przewodowy bez funkcji irygacji? Aktywacja włącznikiem nożnych wszystkich funkcji naraz tj. wibracji ultradźwiękowej, ssania i irygacji w trybie standardowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści aspirator współpracujący z podwójnym drenem ssąco-płuczającym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Dot. Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści aspirator z dwoma uchwytami roboczymi, jednym do tkanek miękkich i jednym do cięcia kości przystosowany do sterylizacji w autoklawie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych jednak wymaga w tym przypadku 2 szt. uchwytów do tkanek miękkich oraz 2 szt. uchwytów do kości.

Pytanie nr 6:

Dot. Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści uchwyty robocze pracujące na częstotliwości 35 +/- 2kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 7:

dot. Wyposażenia. Osprzęt do co najmniej 100 zabiegów

Dot. Pkt. 2, 23 i 24 Czy Zamawiający dopuści wielorazowe końcówki robocze 5 – krotnego użytku do tkanek miękkich, :

dł. 36 mm śr. zew/wew 2,0/1,4mm lub

dł. 98mm śr. zew/wew 2,0/1,4mm lub

dł. 109mm śr. zew/wew 2,3/1,7 mm

KRS: 0000049660



w zestawach do 5 operacji (1 końcówka +5 drenów ssąco-irygacyjnych + 5 osłonek na końcówkę), do wyboru przez Zamawiającego – 18 zestawów (90 zabiegów) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

dot. Wyposażenia. Osprzęt do co najmniej 100 zabiegów

Dot. Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści jednorazową końcówkę typu raszpla, do rzeźbienia kości, długość 38mm lub 100 mm o powierzchni raszpli 4mm² do wyboru przez Zamawiającego – 4 szt.?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 9:

Wyposażenia. Osprzęt do co najmniej 100 zabiegów

Dot. Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści jednorazową końcówkę typu nóż, do cięcia kości, długość 36mm lub 101 mm , dł. cięcia 10mm szer. cięcia 0,8mm do wyboru przez Zamawiającego – 16 szt.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 10:

Dot. Pkt. Nr 27.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pojedynczy dren irygacyjny do uchwytu 35 kHz do końcówek do cięcia i rzeźbienia kości – 20 szt.

Dreny ssąco- płuczące są w zestawach z końcówkami pyt. Nr 9(pkt 22,23,24) w ilości 90 szt.

Razem drenów jest 110 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jednorazowy pojedynczy dren irygacyjny do uchwytu 35 kHz do końcówek do cięcia i rzeźbienia kości – 20 szt. ale tylko wtedy gdy suma wszystkich zaoferowanych drenów będzie wynosić min. 108 (tj. dreny do użytku z końcówką do kości oraz końcówką do tkanek miękkich). W załączeniu zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 11:

Dot. Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści zbiornik aspiracyjny wielorazowego użytku – 1 szt. z jednorazowymi wkładami do zbiornika aspiracyjnego – 110 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 12:

Pytania dotyczące Załącznika nr 6 – Zestawienia Parametrów Technicznych:

Czy w punkcie 22. Zamawiający dopuści końcówkę wielorazową przedłużoną Micro o gładkim zakończeniu do tkanek miękkich, długość 121,5 mm, średnica wew. 1,6 mm ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale w ilości wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli końcówka jest przeznaczona do 5 krotnego użytku to Wykonawca powinien zaproponować proporcjonalną ilość. (wymagamy 52 szt. więc przy końcówce 5 krotnego użytku Wykonawca powinien zaproponować min. 11 szt.). W załączeniu zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 13:

Pytania dotyczące Załącznika nr 6 – Zestawienia Parametrów Technicznych:

Czy w punkcie 23. Zamawiający dopuści końcówkę wielorazową przedłużoną Standard o gładkim zakończeniu do tkanek miękkich, długość 114,4 mm, średnica wew. 2,0 mm ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale w ilości wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli końcówka jest przeznaczona do 5 krotnego użytku to Wykonawca powinien zaproponować proporcjonalną ilość. (wymagamy 4 szt. więc przy końcówce 5 krotnego użytku Wykonawca powinien zaproponować min. 1 szt.). W załączeniu zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 14:

Czy w punkcie 24. Zamawiający dopuści końcówkę jednorazową z ząbkami do tkanek miękkich, długość 78,7 mm, średnica wew. 2,0 mm ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 15:

Czy w punktach 25. i 26. Zamawiający dopuści końcówkę jednorazową z ząbkami do kości, długość 167,1 mm, średnica wew. 1,1 mm ?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Punkt 13. ma brzmienie „Uchwyt roboczy wyposażony w przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny, częstotliwość pracy w zakresie minimum 23-26 kHz”:

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający miał na myśli zakres 23 – 36 kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych



Pytanie nr 17:

W punkcie 18 Zamawiający przewidział punktację i dopuścił odpowiedź „NIE” dla sterownika ręcznego. W punkcie 29 jest sterylna folia do sterownika ręcznego z punktu 18.

Prosimy o dopuszczenie odpowiedzi „NIE” W kolumnie „Parametry oferowane” co będzie oznaczało spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów w punkcie 29, który jest powiązany z punktem 18.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje punkt 29, który otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Opis parametru, funkcji	Parametry wymagane	Parametry oferowane
29.	Sterylna folia do sterownika ręcznego– 108 szt.	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	Zgodnie z Wykazem do oceny załącznikiem nr 7 do SWZ

W załączeniu zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych oraz załącznik 7 WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH poprzez dopisanie punktu 29:

29.	Sterylna folia do sterownika ręcznego– 108 szt.	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	TAK/NIE*
-----	---	---	----------

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt.5. – Wydajność pompy irygacyjnej od 5 do 50 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 7 – uchwyt roboczy kompatybilny z końcówkami do cięcia tkanek miękkich oraz uchwyt roboczy cięcia kości

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych jednak wymaga w tym przypadku 2 szt. uchwytów do tkanek miękkich oraz 2 szt. uchwytów do kości.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 12 - Uchwyty roboczy kompatybilny z końcówkami do cięcia tkanek miękkich i uchwyt do cięcia kości przystosowany do sterylizacji w autoklawie. -2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych jednak wymaga w tym przypadku 2 szt. uchwytów do tkanek miękkich oraz 2 szt. uchwytów do kości.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt.13 - Uchwyt roboczy wyposażony w przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny, częstotliwość pracy w zakresie minimum 22,5-23 kHz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 14 – Funkcja selektywności tkanek kontrolowana za pomocą systemu DTR (Dinamic Tissue Response) poprzez kontrolę amplitudy drgań końcówki

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt.18 – sterowanie aparatem za pomocą ekranu dotykowego

Odpowiedź:

Parametr punktowany nie trzeba go spełniać. Funkcja sterowania z ekranu dotykowego nie jest traktowana jako oddzielny sterownik.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 22 – Jednorazowa końcówka o gładkim zakończeniu do tkanek miękkich, długość od 76 mm do 184 mm, średnica zew. 1,1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm do wyboru przez Zamawiającego – 52 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 23 - Jednorazowa końcówka głębokiego dostępu o gładkim zakończeniu ze zmodyfikowaną budową chroniącą tkanki, do tkanek miękkich, długość 115mm, średnica zew. 1,9 mm – 4 sztuki



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt.24 - Jednorazowa końcówka z ząbkami do tkanek miękkich, średnica zew. 1,9 mm – 32 sztuki




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 25 - Jednorazowa końcówka zagięta do cięcia kości, – 4 szt.

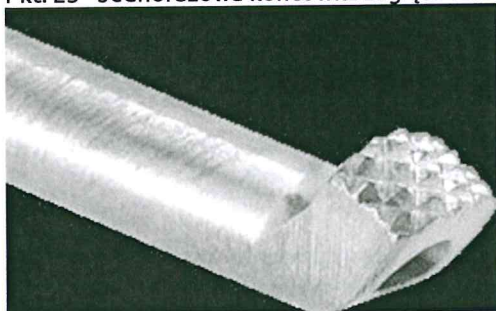


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy Aspirator ultradźwiękowy nieznacznie różniący się od opisanego w SIWZ a spełniający te same funkcje i pozwalający wykonać co najmniej te same procedury medyczne.

Pkt. 26 - Jednorazowa Końcówka płaska z ząbkami do cięcia kości 20 mm – 16 szt

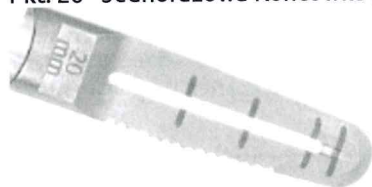

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Zamawiający przesuwają termin składania ofert:
z 07.06.2022 r. godz. 10⁰⁰ na 14.06.2022 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwają termin otwarcia ofert
z 07.06.2022 r. godz. 10³⁰ na 14.06.2022 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych