

Katowice dn. 08.06.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa wyrobów medycznych jedno i wielorazowego użytku D/ZP/381/39A/17

Pytanie nr1

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu poz 1 z pakietu nr 87 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 87 poz 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml. pH - 7.0-7.4, osmolarność - 270 – 330 mOsm/kg.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 87 poz 3 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypanblue + 0,03% blue life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml. pH - 7.0-7.4, osmolarność - 270 – 330 mOsm/kg.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 88 poz 1 roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0.18% w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 88 poz 2 roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0.05% w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr6**Dotyczy: D/ZP/381/39A/17, Pakiet 83, ilość pozycji 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10 (numer katalogowy: ODF20P). Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr7**Dotyczy: D/ZP/381/39A/17, Pakiet 98, ilość pozycji 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych światłoczułych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10 (numer katalogowy: ODF20P). Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe światłoczułe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr8**Dotyczy: D/ZP/381/39A/17, Pakiet 98, ilość pozycji 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych światłoczułych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10 (numer katalogowy: ODF20P). Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe światłoczułe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr9**Dotyczy: D/ZP/381/39A/17, Pakiet 98, ilość pozycji 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych światłoczułych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10 (numer katalogowy: ODF20P). Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe światłoczułe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr10**Dotyczy: D/ZP/381/39A/17, Pakiet 100, ilość pozycji 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10 (numer katalogowy: ODF20P). Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr11**Dotyczy: D/ZP/381/39A/17, Pakiet 100, ilość pozycji 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10 (numer katalogowy: ODF20P). Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu 83 oraz pozycji 1, 2 i pozycji 3 z Pakietu 98 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr13**PAKIET NR 32****Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością docięcia 55/70 mm (wys. x szer.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością docięcia 55/70 mm (wys. x szer.)

Pytanie nr14

Załącznik Nr 4.82 do SIWZ - Pakiet nr 82 - System do pobierania krwi:

poz. 11: czy Zamawiający dopuści Probówkę do pobierania krwi na gazometrię, zawierająca heparynę litu, wielkość 2,3 ml, kompatybilną z igłą systemową opisaną w pkt. 14 niniejszej tabeli?

poz. 3, 4, 5, 6, 11 i 12: czy Zamawiający, ze względu na specyfikę zastosowanego odczynnika, którego termin ważności określony przez producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, dopuści próbówki z terminem ważności wynoszącym minimum 2/3 okresu ważności określonego przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbówki do pobierania krwi na gazometrię, zawierającą heparynę litu, wielkość 2,3 ml, kompatybilną z igłą systemową opisaną w pkt. 14 załącznika 4.82 do SIWZ, w pozostałym zakresie Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 26 zestawów do żył centralnych z cewnikiem jednokanałowym 14 Ga lub 16 Ga, długość 15cm lub długość 20cm; ; przewodnikiem 032 x 45cm odpornym na załamania w osi długiej oraz odporny na rozwarstwienia, igłą 18Ga x 7cm, strzykawką 5ml, rozszerzaczem naczyniowym, skalpelem oraz fiksatorem z możliwością ufiksowania wkłucia przy skórze niezależnie od głębokości jego wprowadzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 44 poz. 1 zestawów z linią do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h – pojedynczych. Długość linii ciśnieniowych 120 cm+30 cm, dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita linii 152 cm). Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70ml/h poprzez podwójny system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo-skrzydełka i wpustek. Biureta zabezpieczona filtrem i trzema otworami w kolcu. Częstotliwość własna przetwornika > 200, kompletnej linii > 49Hz. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza do 1,5%. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatraskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 2 koreczki. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełniania linii. Produkt sterylne, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Informacja na opakowaniu jednostkowym w języku polskim. Kompatybilny z posiadanymi przez Szpital kablami.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr17

Pakiet nr 8, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny z nadrukowaną skróconą nazwą producenta, rozmiarem rurki oraz średnicą mankieta, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr18

Pakiet nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr19

Pakiet nr 10, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch póloringów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr20

Pakiet nr 10, poz. 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nieprzepuszczalności podtlenku azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr21

Pakiet nr 10, poz. 5: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr22

Pakiet nr 33, poz. 2: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr23

Pakiet nr 47, poz. 17-21: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr24

Pakiet nr 105, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę 0,33x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr25

Pakiet nr 105, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dokładaną igłą w rozmiarze 0,45x13?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr26

pakiet 16

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorecza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr27

pakiet 16

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez zaczepu na dren?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr28

Pakiet 23

poz. 20

Czy Zamawiający wymaga stażę bezlateksową na rolce, opakowanie 25 szt., instrukcja użytkowania na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr29

Pakiet 23

poz. 20

Czy Zamawiający wydzieli poz. 20 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr30

Pakiet 33

poz.1 Czy Zamawiający dopuści worerk na mocz 2l, jednorazowego użytku,sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr31

Pakiet 34

Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga wzierniki pakowane folia+papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr32

Pakiet 47

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr33

Pakiet 47

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr34

Pakiet 47

Poz. 2

Czy Zamawiający wymaga osłonki pakowane a'144 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr35

Pakiet 47

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr36

Pakiet 47

Poz. 7

Czy Zamawiający wymaga sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz zbiorcze opakowanie zawierające 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr37

Pakiet 47

Poz. 9-14

Czy Zamawiający dopuści:

STRZYKAWKI TRZYCZĘŚCIOWE LUER LOCK POLMIL

- JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

- STERYLNE (STERYLIZOWANE TLENKIEM ETYLENU)

- WYKONANE Z MEDYCZNEJ KLASY POLIPROPYLENU (CYLINDER, TŁOK)

I POLIIZOPRENU (USZCZELKA)

- PRZEZROCZYSTY CYLINDER DOKŁADNIE POKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ STRZYKAWKI
- WYRAŹNE ZNACZNIKI SKALI
- NIE ZAWIERAJĄ LATEKSU
- OPAKOWANIE TYPU BLISTER?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr38

Pakiet 47

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 2 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr39

Pakiet 49 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a' 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr40

Pakiet 49 poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakiet? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr41

Pakiet 103

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 wycenę za opakowanie a' 200 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr42

Pakiet 103

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wycenę za opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr43

Pakiet 103

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 pincetę o dł. 13 cm, sterylną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr44

Pakiet nr 24 – Filtr oddechowy jednorazowy bakteryjny do spirometrii, komory inhalacyjne

Czy Zamawiający dopuści komorę inhalacyjną o objętości 203,85ml i całkowitej długości 16,0cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr45**Pyt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.

Pytanie nr46**Pyt. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 dopuści pierścienie dotorebkowe wyłącznie o średnicy 11 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr47

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 94 dopuści sterylne strzałki wykonane z celulozy, bardzo chłonne, szybko odprowadzające wilgoć , zachowujące sztywność podczas absorpcji, długość całkowita 75 mm,

długość gąbki 15 mm, ostro zakończone w opakowaniu handlowym zawierającym 40 sterylnych blistrów po 5 sztuk strzałek(200 szt/op)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr48**Pyt. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 114 dopuści 1,4% kwas hialuronowy, ph: 6,8-7,6, lepkość ($0,1 \text{ s}^{-1}$) 120 000 mPas, masa cząsteczkowa powyżej $3,2-3,5 \times 10^6 \text{ Da}$, osmolarność 280-330 mOsm/l, w ampułkostrzykawce o pojemności 1ml ze sterylną kaniulą 25G?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr49**Pyt. 5**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust. 12 umowy, który otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie nr50**Pyt. 6**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5, ust. 1, lit. a,b,c Wzoru Umowy:

1. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :*
 - a) *w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej,*
 - b) *w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,*
 - c) *w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmniejsza wysokości kar umownych określonych w § 5 ust. 1 umowy.

Pytanie nr51**Pakiet 69****Poz. 1, 3, 4**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 3 i 4 do osobnego pakietu, co , co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr52**Pakiet 5**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: dren typu Redon o długości 50 cm, perforowany na odcinku 8 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr53

Pakiet 49

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 49 pozycji nr 2 i stworzenie z niej niezależnego pakietu, co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców i zaoferowanie produktu wysokiej jakości w korzystnej cenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr54

Pakiet 49

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w zakresie pakietu 49, pozycji 2 dopuści: Kaniule bezpieczną dożylną z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, konstrukcja korka portu bocznego, utrudniająca samoczynne otwieranie się korka portu, koreczek portu bocznego domykany standardowo, filtr hydrofobowy, cewnik posiadający trzy dobrze widoczne paski kontrastujące w promieniach RTG ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr55

Pakiet 100

Pyt. - Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuści: Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy wykonany z silikonu oraz ogranicznik przepływu, urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10 % nominalnego czasu wlewu, urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych, przez który podawana jest zawartość, pompa pracuje w systemie zamkniętym, posiada filtr 0.03 µm na przebiegu linii, który służy odpowietrzaniu i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, pompy wyposażone w układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, co gwarantuje, że układ jest zamknięty i zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki, system automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zapobiega rozproszeniu zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków,

Poz.1 - czas infuzji 48h przy wypełnieniu pompy objętością 240 ml, objętość maksymalna 360 ml, prędkość przepływu 5ml/h

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr56

Pakiet 100

Pyt. - Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuści: Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy wykonany z silikonu oraz ogranicznik przepływu, urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10 % nominalnego czasu wlewu, urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych, przez który

podawana jest zawartość, pompa pracuje w systemie zamkniętym, posiada filtr 0.03 µm na przebiegu linii, który służy odpowietrzaniu i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, pompy wyposażone w układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, co gwarantuje, że układ jest zamknięty i zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki, system automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zapobiega rozproszaniu zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków,

Poz. 2 – czas infuzji 24h przy wypełnieniu pompy objętością 240 ml, objętość maksymalna 360 ml, prędkość przepływu 10ml/h ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr57

Dotyczy pakietu nr 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie Pakiecie nr 23 próbówki do surowicy z trombiną (pozycja nr 6) do oddzielnego pakietu lub o wyrażenie zgody na zaoferowanie w tej pozycji próbowek do surowicy z aktywatorem wykrzepiania z czasem wykrzepiania 30 min. Pozostawienie próbówki z trombiną w głównym pakiecie powoduje, że tylko jedna firma może spełnić wymagania, dlatego wyrażenie zgody na jedno z powyższych rozwiązań pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej w SIWZ.

Pytanie nr58

Dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 14 rozwiązania równoważnego w postaci uchwytu z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym? W takim przypadku należałoby zmniejszyć ilość uchwytów z pozycji nr 11 o 4800 szt., a zwiększyć o 4800 szt. ilość igieł systemowych z pozycji nr 13. Rozwiązanie w postaci uchwytu z zabezpieczeniem jest bardziej uniwersalne. Taki chwyt może być używany również z igłami przeziernikowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej w SIWZ.

Pytanie nr59

Pakiet nr 45:

Lp.1 Czy Zamawiający będzie wymagał kołderki jednorazowej dla dorosłych, okrywającej całe ciało kompatybilnej z urządzeniem do ogrzewania pacjentów MISTRAL AIR PLUS o wymiarach 218 x 127 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr60

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 wymaga aparatu do przygotowywania i pobierania leków z butelek zarówno z filtrem bakteryjnym jak i filtrem cząsteczkowym kompatybilnym z opakowaniami butelek typu Kabi Pac dostępnymi w ramach umowy przetargowej? Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z zadania 1 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, ze znacznikiem RTG o długości 35 cm i rozmiarze FR 20?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr62

Pytanie 1 - pakiet nr 5

Poz. 1- prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu typu Redon z otworem centralnym oraz z krzyżową perforacją na długości 14 cm. Pozostałe parametry tak jak w SIWZ.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie z perforacją na długości 8 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr63

Pytanie 2 - pakiet nr 16

Poz. 3 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ, firmy Polfa Lublin, wykonanego z tworzywa bez zawartości PCV i drenu bez zawartości ftalanów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr64

Pytanie 3 - pakiet nr 16

Poz. 3 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu OCŻ bez informacji na opakowaniu o braku zawartości ftalanów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na opakowaniu obowiązkiem jest umieszczanie informacji jeśli wyrób medyczny posiada ftalany, jeśli nie posiada ftalanów takiego obowiązku nie ma.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr65

Pytanie 4 - pakiet nr 81

Poz.3 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na zużyte igły 0,2 L. tylko kolorze czerwonym. Pojemniki na odpady 0,2 l są przeznaczone na zużyte igły, w związku z tym przepisy dotyczące odpadów medycznych nie dopuszczają używania pojemników na zużyte igły w kolorze żółtym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemnika na zużyte igły 0,2 L. w kolorze czerwonym.

Pytanie nr66

Pakiet 67, pozycja 1,3,4,5

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny, angielskiej marki, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry? Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na

opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi)? Oferowany system charakteryzuje się pojemnikami wielorazowymi bez przyłączy (wszystkie znajdują się w pokrywie wkładu). Wkłady posiadają dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (kompatybilny z drenami o różnej średnicy), o wymaganej średnicy wew. 7mm; nie jest on obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Króciec szeroki (do odsysania ortopedycznego – 12mm) dostępny jest opcjonalnie. Wkłady częściowo sprasowane – ułatwiające magazynowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr67

Pakiet 67, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści saszetkę 20g, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr68

Pakiet 77

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny, angielskiej marki, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry? Wkłady jednorazowe w oferowanym systemie (opis jak dla pak. nr 67) mają pojemność 2 litry. Wkłady do łączenia szeregowego dostępne opcjonalnie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr69

Pakiet 119, pozycja 1

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny (opis jak dla pak. nr 67), angielskiej marki, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry i mocowniki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr70

Pytanie1 do Zadania nr 28

Czy zamawiający, dopuści wysokiej jakości (europejskiego producenta) zestawy do wkłucia centralnego wg poniższej specyfikacji:

Lp.1

Cewnik centralny **czterowiątlowy do kaniulacji** dużych naczyń metodą Seldingera-zestaw. Elementy zestawu:

- Cewnik – kateter czterokanałowy z powłoką antybakteryjną

*Distal 12G (przepływ 8500 ml/h)

*Proximal 18G (przepływ 1350ml/h)

*Medial 1 16G (przepływ 1700ml/h)

*Medial 2 18G (przepływ 1350ml/h) przepływy dla cewnika 20 cm

-igła punkcyjna 18G / 7cm)

-hydrofilne rozszerzacz / dilator 10Fr/12cm

-prowadnik nitinolowy 0,035''x 50 cm -strzykawka Roulesona przelotowa 5ml

- motylek zaciski- fिकासacja przy skórze w zależności głębokości od wprowadzenia cewnika

- bezigłowe zastawki na końcu ramion

Rozmiar 8,5 F długość 15 cm lub 20 cm

Cewnik z poliuretanu (identyfikacja kolorem każdego kanału, miękka końcówką , widoczny w RTG, okrągły przekrój kanałów na całej długości z powłoką przeciwbakteryjną .

Substancja aktywna PHMB (poliheksametylen biguanidu) wprowadzona w strukturę materiału i posiadająca właściwości antyseptyczne , przeciwbakteryjne zarówno na gram + jak i gram -. PHMB aktywne podczas całego okresu utrzymani cewnika w naczyniu.

przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik , brak potrzeby rozłączania zestawu przy aplikacji.

Nitinolowa prowadnica (w umieszczona w specjalnym podajniku w ząbkowaną rolką ułatwiająca jej aplikację,

Elementy zestawu umieszczone na tacce uniemożliwiające wypadanie elementów

Zestaw posiadający etykietę przedstawiającą skład zestawu (grafika parametry elementów) oraz dwie naklejki zawierające: numer katalogowy, numer serii, datę ważności ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr71

Pytanie2 do Zadania nr 27 lp.1/2

Czy zamawiający, dopuści wysokiej jakości (europejskiego producenta) zestawu do wkłucia centralnego wg poniższej specyfikacji:

Lp.1

Cewnik centralny **dwuświatłowy do kaniulacji** dużych naczyń metodą Seldingera-zestaw.

Elementy zestawu:

- Cewnik – kateter dwkanałowy:

*Distal 14G (przepływ 7200 ml/h)

*Proximal 18G (przepływ 1350ml/h) przepływy dla cewnika 20 cm

-igła punkcyjna 18G / 7cm)

-hydrofilne rozszerzacz / dilator 8Fr/12cm

-prowadnik nitinolowy 0,035''x 50 cm

-strzykawka Roulesona przelotowa 5ml

- motylek zaciski –fिकासacja przy skórze w zależności głębokości od wprowadzenia cewnika

- bezigłowe zastawki na końcu ramion

Rozmiar 7 F długość 15 cm lub 20 cm

Cewnik z poliuretanu (identyfikacja kolorem każdego kanału, miękka końcówką , widoczny w RTG, okrągły przekrój kanałów na całej długości, z powłoką przeciwbakteryjną .

Substancja aktywna PHMB (poliheksametylen biguanidu) wprowadzona w strukturę materiału i posiadająca właściwości antyseptyczne , przeciwbakteryjne zarówno na gram + jak i gram -. PHMB aktywne podczas całego okresu utrzymani cewnika w naczyniu.

przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik , brak potrzeby rozłączania zestawu przy aplikacji.

Nitinolowa prowadnica w umieszczona w specjalnym podajniku w ząbkowaną rolką ułatwiająca jej aplikację,

Elementy zestawu umieszczone na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów

Zestaw posiadający etykietę przedstawiającą skład zestawu (grafika parametry elementów) oraz dwie naklejki zawierające: numer katalogowy, numer serii, datę ważności ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Lp.2

Cewnik centralny **trzyświatłowy do kaniulacji** dużych naczyń metodą Seldingera-zestaw.

Elementy zestawu:

- Cewnik – kateter trójkanałowy:

*Distal 14G (przepływ 5800 ml/h)

*Proximal 18G (przepływ 1600ml/h)

*Medial 1 18G (przepływ 1600ml/h) przepływy dla cewnika 15 cm

-igła punkcyjna 18G / 7cm)

-hydrofilne rozszerzacz / dilator 8Fr/12cm

-prowadnik nitinolowy 0,035’’x 50 cm

-strzykawka Roulesona przelotowa 5ml

- motylek zaciski –fikasacja przy skórze w zależności głębokości od wprowadzenia cewnika

- bezigłowe zastawki na końcu ramion

Rozmiar 7 F długość 15 cm lub 20 cm

Cewnik z poliuretanu (identyfikacja kolorem każdego kanału, miękka końcówka , widoczny w RTG, okrągły przekrój kanałów na całej długości, z powłoką przeciwbakteryjną .

Substancja aktywna PHMB (poliheksametylen biguanidu) wprowadzona w strukturę materiału i posiadająca właściwości antyseptyczne , przeciwbakteryjne zarówno na gram + jak i gram -. PHMB aktywne podczas całego okresu utrzymani cewnika w naczyniu.


przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik , brak potrzeby rozłączania zestawu przy aplikacji.

Nitinolowa prowadnica w umieszczona w specjalnym podajniku w ząbkowaną rolką ułatwiająca jej aplikację,

Elementy zestawu umieszczone na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów

Zestaw posiadający etykietę przedstawiającą skład zestawu (grafika parametry elementów) oraz dwie naklejki zawierające: numer katalogowy, numer serii, datę ważności ?

Poniżej zdjęcie poglądowe
Zdjęcia poglądowe zestawu

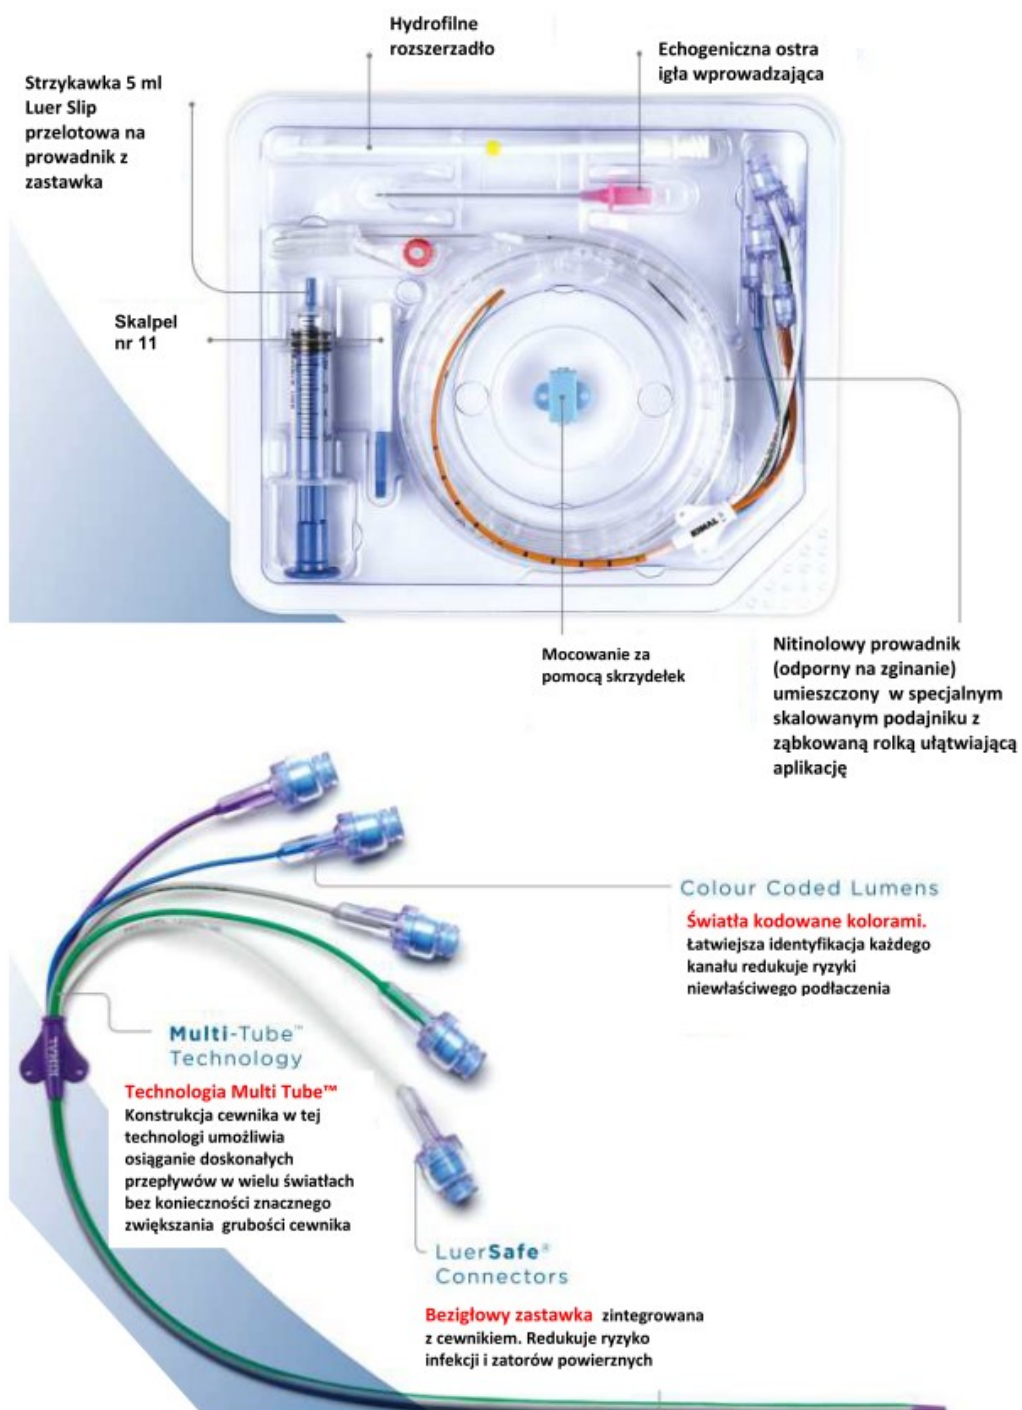

Prowadnik w aplikatorze



Bezigłowa zastawka Luer Safe



Okrągłe światła na całej długości cewnika/ przekrój



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr72

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 98, pozycja 5,6

Prosimy Zamawiającego o informację, czy dopuści igłę wyposażoną w skrzydełka zamiast w miękką platformę zabezpieczającą wklucie do portu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr73**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 98, pozycja 6**

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 5 i 6?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr74

Dotyczy pakietu nr 79. Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Gaz okulistyczny SF6 w pojemniku aluminiowym o pojemności 50 ml do użytku jednorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika zawierający 1 zestaw do iniekcji. Jeden zestaw zawiera: 1 x 50ml strzykawka, 1 x igła 30G, 1x igła 27G, 1 x filtr ze zintegrowanym łącznikiem, 1 x kurek trójdrożny, 1 x opaska na nadgarstek pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr75

Dotyczy pakietu nr 79. Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Gaz okulistyczny C3F8 w pojemniku aluminiowym o pojemności 50 ml do użytku jednorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika zawierający 1 zestaw do iniekcji. Jeden zestaw zawiera: 1 x 50ml strzykawka, 1 x igła 30G, 1x igła 27G, 1 x filtr ze zintegrowanym łącznikiem, 1 x kurek trójdrożny, 1 x opaska na nadgarstek pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr76

Dotyczy pakietu nr 79. Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zaproponowanie zamiast zestawu opisanego w SIWZ, kompletnego zestawu zawierającego : 1 zestaw do iniekcji. Jeden zestaw zawiera: 1 x 50ml strzykawka, 1 x igła 30G, 1x igła 27G, 1 x filtr ze zintegrowanym łącznikiem, 1 x kurek trójdrożny, 1 x opaska na nadgarstek pacjenta; oraz gaz okulistyczny w pojemniku aluminiowym o pojemności 50 ml do użytku jednorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika(SF6 lub C3F8 – do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo podczas składania zamówienia jednostkowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr77

Dotyczy pakietu nr 79. Pozycje 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga gazu o czystości nie niższej niż 99,9% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa czystości.

Pytanie nr78

Dotyczy pakietu nr 88. Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, opakowanie: sterylne fiolki o pojemności 1,0 ml; minimalne opakowanie handlowe zawiera 5 oddzielnych, sterylnych opakowań jednostkowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr79

Dotyczy pakietu nr 88. Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06 % rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, opakowanie: sterylne fiolki o pojemności 1,0 ml; opakowanie handlowe zawiera 5 oddzielnych, sterylnych opakowań jednostkowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr80

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie **kranika trójdrożnego „LIPIDOWEGO”**: jednorazowy, sterylny, z wyczuwalnym optycznym indykatozem, płaska czysta powierzchnia, objętość wypełnienia 0,23ml, prosty tor przepływu w obu kierunkach, wykonane z poliwęglanu, polietylenu, polipropylenu, sterylizowane tlenkiem etylenu, możliwość podawania tłuszczu i chemioterapeutyków. Bez lateksu, pakowane pojedynczo. Kranik trójdrożny sterylizowany promieniami Beta jest oferowany tylko przez jednego producenta w Polsce tj. firmę Becton Dickinson i nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim.

Odpowiedź:

Z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku wynika, że przynajmniej dwóch producentów oferuje kraniki trójdrożne „lipidowe”. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr81

Dotyczy Pakietu nr 47 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie **kranika trójdrożnego**: jednorazowy, sterylny, z wyczuwalnym optycznym indykatozem, płaska czysta powierzchnia, objętość wypełnienia nie większa niż 0,23ml, prosty tor przepływu w obu kierunkach, wykonane z poliwęglanu, polietylenu, polipropylenu, sterylizowane tlenkiem etylenu, możliwość podawania tłuszczu i chemioterapeutyków, bez lateksu, pakowane pojedynczo. Kranik trójdrożny sterylizowany promieniami Beta jest oferowany tylko przez jednego producenta w Polsce tj. firmę Becton Dickinson i nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim.

Odpowiedź:

Z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku wynika, że przynajmniej dwóch producentów oferuje kraniki trójdrożne „sterylizowane radiacyjnie”. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr82

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu w rozmiarze 18Ch, długość 60 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr83

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu w rozmiarze 20Ch, długość 60 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr84**Dotyczy pakietu nr 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 15 Igły systemowej motylkowej z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym o dł. ostrza 19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w poz. nr 15 Igły systemowej motylkowej z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym o dł. ostrza 19mm

Pytanie nr85

Pakiet 43 – Akcesoria do EMG i EEG

Poz. 1:

Zamawiający nie określił gramatury pasty do mocowania elektrod EEG.

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie o pojemności 228g?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr86

Pakiet 43 – Akcesoria do EMG i EEG

Poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowej o konstrukcji stalowej, powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach 37 mm x 0,46 mm (26G), o powierzchni czynnej 0,07 mm², z uchwytem wyposażonym w znacznik kierunku powierzchni czynnej oraz klips zabezpieczający, pakowanej po 25 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. elektrodę igłową.

Pytanie nr87

Pakiet 73 – Pasty przewodzące

Poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści żel w tubce 250g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr88**Pakiet 59 - Akcesoria do respiratora Astral 150****Pytanie 1**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby obwód pojedynczy z zastawką był wyposażony w szybkozłączce zapobiegające nieprawidłowemu podłączeniu do respiratora?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr89**Dotyczy pakietu nr 23**

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 17 igły o długości 25mm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr90**Dotyczy pakietu nr 23**

- Czy Zamawiający w poz.16 i 17 biorąc pod uwagę fakt, iż bez względu na wielkość wizjera w igłach przeziernych, objętość krwi w nich uwięzionej jest identyczna (około jednej kropli krwi) oraz w celu maksymalizacji widoczności prawidłowego umieszczenia igły w żyłę wymaga wizjera o długości min. 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr91**Dotyczy pakietu nr 23**

- Czy w poz. 14,15 i 17 Zamawiający chroniąc personel pobierający krew przed zakłuciami oraz zgodnie z CDC i European Biosafety Network, które mówią wyraźnie, że bezpieczne igły to takie, w których „mechanizm zabezpieczający jest zintegrowany z igłą” wymaga zaoferowania igły z zabezpieczeniem ostrza umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem z możliwością aktywowania zabezpieczenia jedną ręką, bez wykonywania dodatkowych ruchów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr92**Dotyczy pakietu nr 23**

- Czy Zamawiający w poz. 8 w probówkach do koagulologii ze względu na ograniczenie aktywacji płytek i optymalizację monitorowania APTT, w szczególności u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną, wymaga minimalnej przestrzeni martwej do max. 1 cm³ ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr93**Dotyczy pakietu nr 23 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16 igły o długości 25mm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr94**Dot. pakietu nr 23 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu przydatności w zakresie pakietu nr 23 poz. 8 (próbówki do badań koagulologicznych) do 4 miesięcy od dnia dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr95**Dot. pakietu nr 23**

Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie pakietu nr 23 Zamawiający wymaga dostaw do Apteki Szpitalnej znajdującej się przy ul. Ceglanej 35 czy do innej jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem §2 ust. 9 umowy dostawy będą realizowane do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 lub w lokalizacji w Katowicach przy ulicy Medyków 14.

Pytanie nr96**dot. pakietu nr 82 poz. 6 – system do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści próbówki do badań koagulologicznych o poj. 1,4-1,8 ml kompatybilne z igłą systemową opisaną w pkt.14 tabeli asortymentowo-cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr97**dot. pakietu nr 82 poz. 10 – system do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści próbówki do hematologii z EDTA o poj. 1-1,6 ml kompatybilne z igłą systemową opisaną w pkt. 14 tabeli asortymentowo-cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr98**dot. wzoru umowy par. 2 pkt. 9**

Prosimy o modyfikację pkt. 9 i dopisanie: „Wykonawca ponosi koszty transportu (...) przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 2 ust. 9 umowy

Pytanie nr99

Czy Zamawiający w pakiecie 114 dopuści 1,4% hialuronian sodu, czysty, syntetyczny, rozpuszczony w fizjologicznym zbuforowanym roztworze o wartości pH 6,0-8,0 , sterylny , apyrogenny, lepkość 40 000 -70 000mPas, masa cząsteczkowa 1,1-2,6 MDa, osmolarność 270-400mOsm/kg, zapakowany w ampułkostrzykawkę o pojemności 1ml z dołączoną sterylną kaniulą 27G?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr100**Dotyczy Pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr101**Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkową gałęzią do worka rozciągalną do 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr102**Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łącznik z portem do odsysania o średnicy 3.2 mm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr103**Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznej jakości miękkiego PCV, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr104**Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o średnicy wewnętrznej 29.25 mm, stosowany bezpośrednio ze spirometrami firmy Jeager (Masterlab, Masterscreen) oraz do spirometrów PK Morgan przy użyciu dodatkowego adaptera, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr105

Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr106

Dotyczy Pakietu nr 36

Czy Zamawiający dopuści mankiety wykonane z delikatnego TPU- kodowane kolorystycznie piktogramem zwierząt, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr107

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji 99.999%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr108

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji wirusowej 99.999% i bakteryjnej 99.9999%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr109

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1200 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr110

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr111

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 32 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr112

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 33 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr113

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g i objętości oddechowej 200-1500 ml, spełniający wszystkie pozostałe parametry, tak jak filtr bez zastrzeżeń stosowany obecnie przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr114

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji 99.999%?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr115

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji wirusowej 99.999% i bakteryjnej 99.9999%?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr116

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1200 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr117

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr118

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 53 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr119

Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g i objętości oddechowej 200-1500 ml, spełniający wszystkie pozostałe parametry, tak jak filtr bez zastrzeżeń stosowany obecnie przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr120

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr121

Dotyczy Pakietu nr 107 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji 99,999999%, o objętości 54 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr122

Dot.: Pakiet nr 79, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy przygotowany do natychmiastowego użytku jałowy jednorazowy zestaw gazu do tamponady o optymalnym stężeniu roboczym : Sterylna, gotowa do użycia, terapeutyczna stabilna mieszanina 20% Sulfurhexafluoride (SF6) z 80% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 6; czas retencji [tygodnie]: 1 do 2; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 20; Własności fizyczne: gęstość względna w odniesieniu do suchego powietrza (przy 15 °C, 1 bar) [g/cm³]: 5,106; ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr, opaska na nadgarstek pacjenta.

W przypadku akceptacji powyższego rozwiązania prosimy o podanie wymaganej ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr123

Dot.: Pakiet nr 79, poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy przygotowany do natychmiastowego użytku jałowy jednorazowy zestaw gazu do tamponady o optymalnym stężeniu roboczym :

Sterylna, gotowa do użycia terapeutyczna stabilna mieszanina 12% Octafluoropropane (C3F8) z 88% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 30; czas retencji [tygodnie]: 6 do 8; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 12; Własności fizyczne: gęstość względna w odniesieniu do suchego powietrza (przy 15 °C, 1 bar) [g/cm³]: 6,610; ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr, opaska na nadgarstek pacjenta.

W przypadku akceptacji powyższego rozwiązania prosimy o podanie wymaganej ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr124

Dot.: Pakiet nr 79, poz. 3

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania dot. poz. 1 i 2 Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy asortymentu wymienionego w poz. 3 (wchodzą w skład oferowanych zestawów gazu do tamponady).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr125

Dot.: Pakiet nr 89, poz.

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy olej do tamponady :

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm³]: 0,97

Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr126

Dot.: Pakiet nr 118, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kaniulę do dróg łzowych typ M9275 lub M9276, jak na rys. :



Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 118 w pozycji nr 1 kaniul w rozmiarze 0,45 x 28mm 26G. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr127

Dot.: Pakiet nr 118, poz.2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kaniulę do dróg łzowych typ jak na rys. :



7021 Lacrimal Cannula
21G x 1 1/4 in (.80 x 32mm)

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 118 w pozycji nr 2 kaniul w rozmiarze 0,8 x 35mm 21G . Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr128

Dot. umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr129

Pakiet 111, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny przejrzystą o lekko mlecznym zabarwieniu spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr130

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 69 pozycji 1,3,4. Umożliwi to przedstawienie bardziej korzystnej oferty na te pozycje.

**Pakiet
nr 69**

Czujnik Nelcor, Rurka CPAP, opaska typu Pasey

L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość
1.	Czujnik plasterkowy jednorazowy do saturacji dla noworodków o wadze mniejszej lub = 3kg (do współpracy z pulsoksymetrem Nellcor N-550B)	szt	864
2.	Rurka CPAP, wykonana z miękkiego silikonu, posiadająca dwa krótkie tubusy dla łatwiejszego i niedrażniającego umieszczenia w przewodach nosowych u noworodków. Piankowa gąbka redukująca ciśnienie przepływu. Boczne skrzydełka pozwalające na umocowanie rurki na główce dziecka. Rozmiary: XS - waga poniżej 1000g, S - waga poniżej 1500g, L - waga powyżej 1500g	szt	100
3.	Czujnik wielorazowego użytku do pulsoksymetru Nellcor typu D-YS	szt	24
4.	Opaska mocująca typu Poseyop=12 szt	op	24

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr131

Pytanie do pakietu nr 30 Materiały zużywalne do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków do aparatu Infant FlowSiPAP system LP

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10.

W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do poz. nr 3 końcówek donosowych w rozmiarach XS,S,M,L.

Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wydzielił z Pakietu nr 30 pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 końcówek donosowych w rozmiarach XS,S,M,L.

Pytanie nr132

Pytanie do pakietu nr 63 Układy oddechowe do SLE 2000,BEAR 2001.,filtry i komora

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2,5,

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

A) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 1 układu o niżej podanych parametrach:

Układ oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków, do respiratorów SLE, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułpkę wodną na linii wydechowej; z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa

oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; czerwony adapter monitorujący ciśnienie umiejscowiony przy części Y.

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

B) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 2 układu o niżej podanych parametrach:

Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów SLE, zawierający łącznik pomiędzy częścią Y, a ramieniem wdechowym, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel,

Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

C) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 3 komory o niżej podanych parametrach:

Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ścianie bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Dodatkowo posiadająca:

- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym.
- Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)
- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr133

Pytanie do pakietu nr 70 Sprzęt dla noworodków

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2,3,4,5

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

A) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 1 układu o niżej podanych parametrach:

Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów Bear, Fabian, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułpkę wodną na linii wydechowej; z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; **część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze**, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilzacza MR850 firmy Fisher&Paykel,

Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływakki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

B) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 2 głowic o niżej podanych parametrach:

BC190-05 długość 50 mm
BC191-05 długość 70 mm
BC192-05 długość 100 mm

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

C) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 3 kaniuli o niżej podanych parametrach:

BC 3020-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,0 mm / rozstaw kaniuli 2,0 mm
BC 3520-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,5 mm / rozstaw kaniuli 2,0 mm
BC 4030-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,0 mm / rozstaw kaniuli 3,0 mm
BC 4540-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,5 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm
BC 5040-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm
BC 5050-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm
BC 5550-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm
BC 5560-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm
BC 6060-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm
BC 6070-10	przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 7,0 mm

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

D) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 4 czapeczek o niżej podanych parametrach:

BC300-05	obwód głowy 17-22 cm
BC303-05	obwód głowy 22-25 cm
BC306-05	obwód głowy 25-29 cm
BC309-05	obwód głowy 29-36 cm

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

E) W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 5 maseczek o niżej podanych parametrach:

BC800-10	rozmiar S
BC801-10	rozmiar M
BC802-10	rozmiar L
BC803-10	rozmiar XL

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr134

pakiet nr 88, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści błękit o pojemności 1ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr135

pakiet nr 90) Czy Zamawiający dopuści pierścień tęczówkowy o wielkości 6,3mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr136

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 74 poz. 2 igły półautomatycznej o wymaganych parametrach z możliwością pobrania próbki długości 22mm oraz długości 15mm do wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły półautomatycznej o wymaganych parametrach z możliwością pobrania próbki długości 22mm.

Pytanie nr137

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 74 poz. 3 w odrębny Pakiet np.74A pozwoli to na dopuszczenie innych oferentów a tym samym złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr138

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 77 wkładów jednorazowych na wydzielinę o pojemności 1 litr lub 2 litry kompatybilnych ze ssakiem elektrycznym firmy Medela z nieodpłatnym użyczeniem zbiorników wielorazowych w wymaganych ilościach.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr139**Pakiet nr 62 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów, które posiadają oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr140**Pakiet nr 62 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych włókniny SMMSze wzmocnieniami w części przedniej fartucha o gramaturze 42 g/m² (wymiar wzmocnienie 50 x 100 cm) i na rękawach 40,5 g/m², obwód dolny 170 cm? Fartuchy posiadają oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr141**Pakiet nr 62 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny SMMS, o wytrzymałości na rozerwanie ≥ 40 kPa?

Prosimy o odstąpienie od spełniania wymogu nieprzemakalności- zgodnie z normą EN 13795, w ocenie właściwości i wymagań użytkowych dla odzieży dla bloków operacyjnych (patrz Tablica 3 normy) nie wymaga się badania w/w odzieży pod kątem odporności na przenikanie cieczy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr142**Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr143**Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne silikonowe o długości 50cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr144

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27F w miejsce 28F?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr145

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z otworkami bocznym na długości 14cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr146

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe dla dorosłych o kształcie stożka rozszerzone ku górze?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr147

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z optycznym indykatorem?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr148

Pakiet 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z działką elementarną 0,5ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr149

Pakiet 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z działką elementarną 1ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr150

Pakiet 20 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nakładaną igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr151

Pakiet 20 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,05ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr152

Pakiet 20 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,02ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr153

Pakiet 46 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr154

Pakiet 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści op.a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr155

Pakiet 47 poz. 23

Czy Zamawiający omyłkowo nie opisał resuscytatora dla dorosłych a miał na myśli dla noworodków i dla dzieci?

Odpowiedź

Zamawiający w Pakiecie nr 47 w pozycji nr 23 wymaga resuscytatora dla noworodków i dzieci,

Pytanie nr156

Pakiet 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o nieprzemakalności min. 25,5cm H20, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr157

Pakiet 103 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści op.a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr158

Pakiet 103 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pęsety sterylne o długości 13cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr159**Pakiet 103 poz. 7-8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-8 z zadania 103 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr160**Pakiet 111 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje torby na wymioty z zastawką, która uniemożliwia wydostanie się zapachu i treści na zewnątrz?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr161**Pakiet 117 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik transportowe okrągłe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr162

Pytanie 1 dotyczy **pakietu 49 poz. 1-6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby wszystkie oferowane produkty w poz. 1-6 pochodziły od jednego producenta celem zapewnienia pełnej kompatybilności produktów?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr163

Pytanie 2 dotyczy **pakietu 49 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby osłonka kapilarna chroniąca przed zakłuciem i zachlapaniem po wycofaniu igły ma w pełni zamykać ostrze i światło igły?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie nr164

Pytanie 3 dotyczy **pakietu 49 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonany cewnik oferowanej kaniuli dotętnicznej?

Odpowiedź

PTFE

Pytanie nr165

Pytanie 4 dotyczy **pakietu 19 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki były wyposażone w kolorowe znaczniki – dla oznaczenia linii tętniczej (czerwony) i linii żylniej (niebieski)?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr166

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4 w pozycji 1** dopuści dren brzuszny wykonany z 100% silikonu z atraumatycznym zakończeniem, otwór końcowy, naprzeciwległe rozmieszczone otwory boczne, oraz linia widoczna w rtg, podwójnie pakowany, sterylny długość 50cm, rozmiary 21F, 24F, 28F, 30F?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr167

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 w pozycji 2** dopuści rurki tracheostomijne, jednorazowe, sterylne w rozmiarach 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 spełniające wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr168

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 9 w pozycji 2** dopuści wielorazową prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, rozmiar 15Ch/60cm wykonaną z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, dostarczaną mikrobiologicznie czystą, z możliwością użycia do pięciu razy, z którą zgodnie z instrukcją czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania należy postępować następująco:

1. przed dezynfekcją należy dokładnie umyć w wodnym roztworze obojętnego mydła, usuwając wszystkie widoczne zabrudzenia, spłukać czystą wodą i osuszyć,
2. zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego (Roztwór podchlorynu (0.02%), PovidineIodine (roztwór wodny), 4% kwas octowy lub Sterilox), zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, standardowy czas zanurzenia: 1 godzina,
3. spłukać sterylną wodą, aby przed użyciem usunąć wszelkie pozostałości środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr169

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 w pozycji 1** dopuści maski anestetyczne w rozmiarach: 3 (dla dzieci), 4 (mała dla dorosłych) 4/5 (uniwersalna dla dorosłych) i 5 (duża dla dorosłych), spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr170**Dotyczy części nr72:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści trzy łączniki dostępu dożylnego z przedłużeniem w kształcie „V”?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr171**Dotyczy części nr98:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1, 2,3 produktów nie zawierających ftalanów z potwierdzeniem tej informacji oświadczeniem Producenta, bez nadrukowanej informacji na opakowaniu. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy WE (REACH) zakazuje stosowania ftalanów w wyrobach i jednocześnie zwalnia producentów z konieczności stosowania na opakowaniach oznaczeń o braku ftalanów w przypadku produktów zawierających PVC.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie informacji oświadczeniem producenta.

Pytanie nr172**Dotyczy części nr 99:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego różniący się względem SIWZ:

- długość pojedynczej linii – 10 cm
- prędkość przepływu – 350 ml/min
- z membraną umieszczoną w przezroczystym korpusie łącznika a jej górna powierzchnia jest zlicowana z górną powierzchnią korpusu
- objętość wypełnienia ok. 1,8 ml

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr173**Pakiet nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr174**Pakiet nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr175**Pakiet nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr176**Pakiet nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr177**Pakiet nr 16, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr178**Pakiet nr 16, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr179**Pakiet nr 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach na terenie całej Polski?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr180**Pakiet nr 18, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o rozdzielenie pakietu na dwie pozycje dla kranika z drenem 10 cm oraz kranika z drenem 25 cm, z uwagi na różnorodność cenową asortymentu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr181**Pakiet nr 19, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kranika z optycznym indykatorem pozycji, sterylizowanego tlenkiem etylenu. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez wymóg sterylizacji

promieniami Beta wyraźnie wskazuje na asortyment jednego producenta – firmy Becton Dickinson.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, że przedmiot zamówienia może zaoferować kilku Wykonawców.

Pytanie nr182

Pakiet nr 19, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kranika z przestrzenia martwą 0,32 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr183

Pakiet nr 20, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z stożkiem Luer umiejscowionym centrycznie do tłoka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr184

Pakiet nr 20, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawki w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym,?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr185

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawki w opakowaniu a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym,?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr186

Pakiet nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr187**Pakiet nr 49, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr188**Pakiet nr 49, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli bez osłonki kapilarnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr189**Pakiet nr 49, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kranika z optycznym indykatozem pozycji, sterylizowanego tlenkiem etylenu. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez wymóg sterylizacji promieniami Beta wyraźnie wskazuje na asortyment jednego producenta – firmy Becton Dickinson.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, że przedmiot zamówienia może zaoferować kilku Wykonawców.

Pytanie nr190**Pakiet nr 49, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kranika z przestrzenią martwą (objętość wypełnienia) 0,32 ml.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr191**Pakiet nr 50, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr192**Pakiet nr 50, poz. 16**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr193**Pakiet nr 72, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie łącznika: długość zaworu z drenami 9,5 cm, dren wykonany z PUR (poliuretan), długość drenów 3,0 cm, Ø 1,1 mm-2,35 mm, szybkość przepływu 145 ml/min, membrana wewnętrznie osadzona na konektorze.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr194**Pakiet nr 86, poz. 5-11**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr195**Pakiet nr 99, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z dwoma drenami 9,5 cm, objętość wypełnienia 0,35 ml, szybkość przepływu 143 ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr196

Czy w Pakiecie nr 89 Zamawiający dopuści olej silikonowy o ciężarze wł. 0,98g/cm³ i współczynnika refrakcji: 1,4 ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr197

Czy w Pakiecie nr 90 Zamawiający dopuści produkt w 100 % równoważny tj.: Pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injektorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ?

W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr198

Czy w Pakiecie nr 95 Zamawiający dopuści ryboflawinę z zawartością dextranu 10% i pojemności 1,5ml ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr199

Czy w Pakiecie nr 114 Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% o pojemności 1,1ml, o lepkości: 60.000mPas, masie cząsteczkowej ok. 3mln Da i osmolarności: 300-350 mOsm/kg?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr200

Czy w Pakiecie nr 125 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż jednorazowy EPI Clear do zabiegów EBK jako całość: końcówka (ostrze) zintegrowane z rękojeścią – pakowane po 2 noże w blistrze?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr201

Czy w Pakiecie nr 125 poz. 2 Zamawiający dopuści nóż jednorazowy EPI Clear do zabiegów EBK jako całość: końcówka (ostrze) zintegrowane z rękojeścią – pakowane po 1 nożu w blistrze?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr202

Czy w zakresie pakietów nr 10, 12, 18, 19, 20, 32, 33, 34 Zamawiający odstąpi od warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. V ppkt 1.2)c) SIWZ, dotyczącego wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował określone przez Zamawiającego dostawy?

Odstąpienie od w/w warunku umożliwiłoby złożenie oferty Wykonawcom funkcjonującym na rynku od niedawna (kilku miesięcy), co z kolei przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V ppkt 1.2)c) SIWZ

Pytanie nr203

PAKIET nr 117 (szkiełka, utrwalacze)

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuści do podawania cen jednostkowych za opakowania handlowe a nie za sztukę szkiełek? Ilość opakowań po przeliczeniu na sztuki będzie odpowiadać zamawianej ilości.

Określenie w formularzu cenowym ceny jednostkowej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za sztukę szkiełek podstawowych i nakrywkowych jest niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go produktem rażąco tanim lub o rażąco wysokiej cenie i skutkować może takimi samymi wartościami netto i brutto wśród wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr204

PAKIET 80 (pojemniki na próbki histopatologiczne)

-Czy Zamawiający w pozycjach 4 – 11 dopuści do zaoferowania pojemników na próbki histopatologiczne ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk ?

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody na powyższe proszę o uargumentowanie swojego stanowiska w szczególności odpowiedzią dlaczego uważa , że pojemniki ze szczelną pokrywą zamykaną na wielokrotny wcisk nie są równoważne zamknięciu typu nakrętka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ,

Pytanie nr205

PAKIET 80 (pojemniki na próbki histopatologiczne)

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby pojemniki o pojemności od 250 ml do 10 000 ml były wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta malowana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych i biologicznych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr206

PAKIET 80 (pojemniki na próbki histopatologiczne)

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie produktu numeru identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy służący pełnej identyfikacji produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ?

Odpowiedź Zamawiający wymaga.

Pytanie nr207

PAKIET 80 (pojemniki na próbki histopatologiczne)

Z uwagi na zaistniały proceder jednej z nowych firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego bądź posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie katalogu przedłożenia przez Wykonawców próbek dla pakietu nr 80 po jednej sztuce z najczęściej używanych pojemności : 600-1200 ml, 1000 ml, 5000-5600 ml, 9000-10000 ml w celu potwierdzenia czy oferowane dostawy potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ,

Pytanie nr208

Pytanie 1, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 12 wzoru umowy w brzmieniu następującym:

„Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, jednakże Zamawiający zobowiązany jest do realizacji umowy na poziomie nie mniejszym niż 80% wartości umowy.”

Uzasadnienie: Umowa o udzielenie zamówienia publicznego musi wskazywać minimalny zakres zobowiązania zamawiającego, który zrealizowany zostanie w każdym wypadku. W przeciwnym razie wykonawcy nie zyskują pewności obrotu i nie mogą racjonalnie skalkulować oferty, Zagwarantowanie wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości wskazanej w załączniku umożliwi wykonawcy lepsze, bardziej uzasadnione ekonomicznie i również korzystniejsze dla zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust. 12 umowy, który otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie nr209

Pytanie 2, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu:

*„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe **netto** nie ulegną podwyższeniu. Natomiast w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT ceny brutto ulegną automatycznej waloryzacji stosownie do nowych stawek VAT, przy zachowaniu niezmiennych cen netto.”*

Uzasadnienie: Stawka VAT ujęta w cenie brutto stanowi podatek, a nie ekonomiczny ekwiwalent świadczenia wykonawcy i w związku z tym powinna ulegać automatycznej modyfikacji stosownie do obowiązujących przepisów prawa, bez potrzeby aneksowania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 3 ust. 3 umowy.

Pytanie nr210

Pytanie 3, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 7 lit. a wzoru umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie usuwa zapisu § 7 ust. 7 lit. a z umowy.

Pytanie nr211

Pytanie 4, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 2 zdanie pierwsze wzoru umowy w brzmieniu następującym:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie:

- a) **5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji – w przypadku braków ilościowych,**
- b) **5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji oraz wadliwych towarów – w przypadku braku oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy lub braków jakościowych”.**

Uzasadnienie: Wykonawca nie może ustosunkować się do reklamacji jakościowej oraz wady polegającej na nieprawidłowym oznakowaniu towarów, dopóki nie będzie mógł naocznie zbadać reklamowanego towaru, dlatego w opinii wykonawcy składając pisemną reklamację, zamawiający powinien także przesłać mu wadliwy towar. Zdaniem wykonawcy, pisemna reklamacja jest niewystraszająca do ustalenia, czy faktycznie reklamowany towar jest wadliwy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 2 umowy.

Pytanie nr212

Pytanie 5, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) **w wysokości 0,5% wartości *netto* danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, nie więcej jednak niż 10% tej wartości,**
- b) **w wysokości 0,5% wartości *netto reklamowanych towarów* za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 10% tej wartości,**
- c) **w wysokości 10% wynagrodzenia *netto należnego za niezrealizowaną część umowy* – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”**

Uzasadnienie:

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od wartości netto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest wykonawca;
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia, ponieważ mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. z działania siły wyższej, i w opinii wykonawcy nie jest zasadne karanie w go w takich okolicznościach;
- W przypadku naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki zasadne jest przyjęcie górnego limitu jej naliczania w celu uniknięcia dysproporcji pomiędzy wysokością naliczonej kary umownej a poniesioną przez zamawiającego stratą;
- Kara umowna powinna być naliczana od wartości wadliwej części zamówienia, ponieważ pozostała część zamówienia została wykonana prawidłowo;

- Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, powinna być naliczana od niezrealizowanej części umowy, ponieważ naliczanie kary od całości wynagrodzenia może prowadzić do jej rażącego wygórowania, w szczególności jeżeli wykonawca zrealizowałby 90% przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej,
 - b) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
 - c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr213

Pytanie 6, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 2 lit. b i c wzoru umowy w brzmieniu:

„b. **zwłokaw** zrealizowaniu dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;

c. **Wykonawca jest w zwłoce** z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.”

Uzasadnienie: Opóźnienie może nastąpić również z przyczyn niezależnych od wykonawcy, na przykład z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający. Zamawiający nie może odstąpić od umowy i domagać się zapłaty od wykonawcy kary umownej w sytuacji, gdy wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 2 umowy.

Pytanie nr214

Dotyczy Pakiet 80

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 366 ml

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr215

Dotyczy Pakiet 80

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną

pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 850 ml

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr216

Dotyczy Pakiet 80

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 7 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr217

Dotyczy Pakiet 80

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 8 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr218

Dotyczy Pakiet 80

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 9 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 3400 ml

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr219

Dotyczy Pakiet 80

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 10 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr220**Dotyczy Pakiet 80**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 80 w pozycji 11 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr221**Dotyczy Pakiet 117**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje w pozycji 1 szkiełek ze szkła białego, sodowo-wapniowego o niskiej zawartości tlenu żelaza, o składzie: SiO_2 72,2%, MgO 4,3%, Na_2O 14,3%, Al_2O_3 1,2%, K_2O 1,2%, Fe_2O_3 0,03%, CaO 6,4%, SO_3 0,3% ? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie określił składu chemicznego szkiełek ze szkła białego. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr222**Dotyczy Pakiet 117**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje w pozycji 3 szkiełek nakrywkowych wykonanych ze szkła borosilikatowego typu Menzel o składzie: dwutlenek krzemu (SiO_2) – 64,1%, tlenek boru (B_2O_3) – 8,4%, tlenek glinu (Al_2O_3) – 4,2%, tlenek sodu (Na_2O) – 6,4%, tlenek potasu (K_2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO_2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb_2O_3) – 0,1%. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie określił składu chemicznego. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr223

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy w §3 :

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź

Zamawiający nie dodaje proponowanego zapisu do § 3 umowy.

Pytanie nr224

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych w §5 ust.1 pkt c) na kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 5 ust. 1 lit. c) umowy w zaproponowanym brzmieniu.

Pytanie nr225

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów :

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego .”

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do §5 umowy.

Pytanie nr226

Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? Usprawni to proces zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy, a ponadto pozwoli Zamawiającemu na wcześniejszym etapie zweryfikować poprawność jej zestawienia.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr227

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację §1 poprzez wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadzana proponowanego zapisu do §1 umowy.

Pytanie nr228

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 2 umowy.

Pytanie nr229

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet

minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”

izba uznała ponadto w tym przypadku, że

„Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

W związku z powyższą argumentacją oraz zabezpieczeniem interesów zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie w umowie/modyfikacje zapisów § 2 po przez umieszczenie adnotacji:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust. 12 umowy, który otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie nr230

Pytanie dot. Pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni z drenem inflacyjnym biegnącym przez środek mankietu po jego grzbiecie (co ogranicza podwijanie się koniuszka w trakcie zakładania maski). Z drenem inflacyjnym zintegrowanym w rurce maski i kończącym się powyżej oznakowania głębokości intubacji, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia. Maską posiada skalowanie głębokości prawidłowego usytuowania co 1 cm oraz posiada oznaczenie rozmiaru oraz zakres wagowy na rurce. Maską nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP jest sterylna, pakowana folia-papier, z zabezpieczeniem na balonku pilotowym, w rozmiarach od 1.0 do 6.0 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;) od <5kg do pow. 100kg.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr231

Pytanie dot. Pakietu nr 48 pozycja 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych z hydrofobowym, wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,999% z przestrzenią martwą w zakresie 50-55 ml, objętością oddechową od 150 ml-1200 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr232**Pytanie dot. Pakietu nr 48 pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z celulozową warstwą z możliwością podłączenia tlenu oraz odsysania. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr233**Pytanie dot. Pakietu nr 48 pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 i utworzenie oddzielnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli innym oferentom proponowanie wysokiej jakości produktów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr234**Załącznik Nr 4.60 do SIWZ-****Oprzrządowanie do posiadanego urządzenia ISIS firmy Inomed****PYTANIE 1 do pkt. 1**

Sonda bipolarna z przewodem do bezpośredniej stymulacji nerwów, koncentryczna ofsetowa do guzów kąta m-m (dł. robocza 13cm, dł. całkowita 24 cm, przewód 3m) produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Czy Zamawiający oprócz sondy bipolarnej z przewodem do bezpośredniej stymulacji nerwów opisanej w pkt. 1 wymaga Sondy bipolarnej z przewodem, widełkowej zakończonej kuleczkami o śr. 2 mm, do bezpośredniej stymulacji kory mózgu do operacji z tzw. wybudzeniem oraz do guzów głębokich (dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15,5cm, przewód 3m), produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 szt.? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr235**Zapytanie I – dotyczy Pakietu nr 62**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 jednorazowy, sterylny fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach L, LL, XL, XL-L, które są szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów M, L, XL, XXL w opakowaniu typu folia-folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr236**Zapytanie I – dotyczy Pakietu nr 62**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sterylny fartuch chirurgiczny przeznaczony do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, troki zewnętrzne wszywane, bez ręczników? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr237

Dotyczy pakietu nr 74, poz. nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji wyposażonych w jeden spust bez blokady zabezpieczającej przed przypadkowym zwolnieniem spustu z możliwością wyboru długości próbki 12 lub 25 mm z zakończeniem igły widoczny w USG

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr238

Dotyczy pakietu nr 74, poz. nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji z możliwości wyboru długość próbki 12 lub 25mm, igła skalowana co 1 cm widoczna na USG

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr239

Dotyczy pakietu nr 74, poz. nr 1, 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do w poniższych rozmiarach:

- rozm 14 dł 10 cm,
- rozm 16 dł 10 cm,
- rozm 14 dł 15 cm,
- rozm 16 dł 15 cm.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr240

Dotyczy pakietu nr 53, poz. nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do punkcji mostka z uchwytem motylkowymi płynną regulacją długości 10-30mm i/lub 30-50mm.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr241

Dotyczy pakietu nr 29. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie laryngoskopu światłowodowego jednorazowego użytku wykonany z nierozłącznego bloku (rękojeść + łyżka trwale połączone ze sobą) typu Mecintosh, wykonane z niewrażliwego na temperaturę polipropylenu. Łyżki w rozmiarze: 3, 4. Każdy laryngoskop posiada trwale zintegrowane ze sobą źródło światła.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr242

Pakiet nr 10 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści: Sterylne rurki intubacyjne z mankietem nieprzepuszczającym gazów anestetycznych, w kształcie walca, Oral / nosal, mankiet niskociśnieniowy, otwór Marphyego, nitka kontrastu Rtg na całej długości rurki, gruby oring dookoła rurki widoczny pod kontrolą laryngoskopu, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, oznaczenie głębokości, rozmiar rurki 5– 9,5mm co 0,5 mm, rozmiary będą wskazane każdorazowo w zamówieniu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr243

Pakiet 10 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści: Sterylne rurki intubacyjne z mankietem nieprzepuszczającym gazów anestetycznych, w kształcie walca Oral / nasal, mankiet niskociśnieniowy, otwór Marphyego, nitka kontrastu Rtg na całej długości rurki, gruby oring dookoła rurki widoczny pod kontrolą laryngoskopu rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, oznaczenie głębokości, rozmiar rurki 2,5– 4,5mm co 0,5 mm, rozmiary będą wskazane każdorazowo w zamówieniu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr244

Pakiet 10 pozycja 5. Prosimy o dopuszczenie: Rurka intubacyjna silikonowana, zbrojona, z mankietem o standardowo niskiej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji, średnica rurki podana na korpusie rurki. Rozmiary od 5,0 do 9,0 co 0,5 wskazane każdorazowo w zamówieniu. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu. Pozwoli to większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert. Rurka opisana w tej pozycji jest w ofercie jednego dystrybutora.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, że opisaną w pozycji nr 5 rurkę może zaoferować kilku Wykonawców.

Pytanie nr245

Pakiet 113 pozycja 1. Prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu. Pozwoli to większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr246

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%.”

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust. 12 umowy, który otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie nr247

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe netto nie ulegną podwyższeniu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dodaje proponowanego zapisu do § 3 ust. 3 umowy.

Pytanie nr248

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dodaje proponowanego zapisu do § 3 umowy.

Pytanie nr249

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmniejsza wysokości kar umownych określonych w § 5 ust. 1 umowy

Pytanie nr250

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku, gdy:”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 2 umowy.

Pytanie nr251

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„zmiany stawki podatku od towarów i usług wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 7 ust. 7 lit. a umowy.

Pytanie nr252

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 7 ust. 8 umowy

Pytanie nr253**Pakiet nr 62, poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 62. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr254**Pytanie 1: Pakiet 100, poz. 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści *Przenośny jednorazowy system infuzyjny*:

- posiadający badania stabilności leków, w tym 5FU,
- wykonany z elastomerów,
- z filtrem powietrza na przebiegu linii infuzyjnej, pozwalającym na odpowietrzenie pompy w przypadku, gdy powietrze zostanie wtłoczone do pompy, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania dla personelu i pacjenta,
- obudowa zewnętrzna blokująca promienie UV, umożliwiającą stałą kontrolę wlewu,
- działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym,
- posiadający filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu, łącznik typu Luer-Lock,
- port napełniania umiejscowiony na drenie - co ułatwia manipulowanie strzykawką podczas napełniania pompy,
- dodatkowo posiadający zatyczkę odpowietrzającą, co pozwala napełnić pompę w systemie zamkniętym bez konieczności odpowietrzania pompy poprzez zdjęcie zatyczki,
- objętość nominalna 275 ml, objętość maksymalna do 300ml,
- brak zmiany prędkości przepływu przy zmniejszeniu objętości napełnienia do 70 % wartości nominalnej,
- dokładność dostarczenia żądanej objętości w zakresie 10% nominalnego czasu wlewu,
- nominalny czas infuzji 48 h,
- objętość maksymalna 300 ml,
- nominalna prędkość przepływu 5 ml/h,
- pakowany sterylnie w opakowanie twarde typu blister-pack,
- bez DEHP,
- futerał dla każdego pacjenta,
- wyrób medyczny klasy IIB?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr255**Pytanie 2: Pakiet 100, poz. 2:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści *Przenośny jednorazowy system infuzyjny*:

- posiadający badania stabilności leków, w tym 5FU,
- wykonany z elastomerów,
- z filtrem powietrza na przebiegu linii infuzyjnej, pozwalającym na odpowietrzenie pompy w przypadku, gdy powietrze zostanie wtłoczone do pompy, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania dla personelu i pacjenta,
- obudowa zewnętrzna blokująca promienie UV, umożliwiającą stałą kontrolę wlewu,
- działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym,
- posiadający filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu, łącznik typu Luer-Lock,
- port napełniania umiejscowiony na drenie - co ułatwia manipulowanie strzykawką podczas napełniania pompy,

- dodatkowo posiadający zatyczkę odpowietrzającą, co pozwala napełnić pompę w systemie zamkniętym bez konieczności odpowietrzania pompy poprzez zdjęcie zatyczki,
- brak zmiany prędkości przepływu przy zmniejszeniu objętości napełnienia do 70 % wartości nominalnej,
- dokładność dostarczenia żądanej objętości w zakresie 10% nominalnego czasu wlewu,
- nominalny czas infuzji 24 h,
- objętość maksymalna 300 ml,
- nominalna prędkość przepływu 10 ml/h,
- pakowany sterylnie w opakowanie twarde typu blister-pack,
- bez DEHP,
- futerał dla każdego pacjenta,
- wyrób medyczny klasy IIB?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr256

§3

Prosimy zamawiającego o dodanie zapisu umowy dotyczącego stawki podatku vat o następującej treści: „W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku vat, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto natomiast cena netto pozostanie bez zmian.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dodaje proponowanego zapisu do § 3 ust. 3 umowy.

Pytanie nr257

Pakiet nr 47 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków za opakowanie handlowe równe a'80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr258

Pakiet nr 47, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłon na głowice za opakowanie handlowe równe a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr259

Pakiet nr 47, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny strzykawki trzyczęściowej luer-lock o pojemności 20 ml za opakowanie handlowe a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr260

Pakiet nr 47, poz. 18-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę igieł do nakłuć lędźwiowych o długości 88 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr261**Pakiet nr 50 poz. 5-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę elektrod ekg za opakowanie handlowe równe a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr262**Pakiet nr 50 poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu bezigłowego przeznaczonego do użytku na 7 dni lub 720 aktywacji, o objętości wypełnienia 0,07 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr263**Pakiet nr 50 poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę bezigłowej nasadki na fiolkę przeznaczoną do użytku na 7 dni lub 720 aktywacji, o objętości wypełnienia 0,07 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr264**Pakiet nr 50 poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poczwórnego bezigłowego portu iniecyjnego z przedłużaczami o długości 8 cm, z możliwością do 720 aktywacji, o objętości wypełnienia 0,2 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr265**Pakiet nr 72 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje łącznika z trzema drenami zakończonymi portami bezigłowymi aktywowanymi końcówkami typu luer lub luer-lock?

Odpowiedź

Zamawiający tego oczekuje.

Pytanie nr266**Pakiet nr 103 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szpatulek laryngologicznych za opakowanie handlowe równe a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr267

Pakiet nr 70: Poz. 1 Układ oddechowy

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr268

Pakiet nr 70: Poz. 1 Układ oddechowy

Czy z uwagi na ekonomiczne wydatkowanie środków publicznych Zamawiający wymaga aby układ posiadał 14-dniowy termin stosowania? Dzięki tej właściwości układu oddechowego Zamawiający oszczędza środki finansowe oraz przyczynia się do zmniejszenia ilości produkowanych przez Szpital odpadów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr269

Pakiet nr 70: Poz. 1 Układ oddechowy

Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza dostarczana z układem posiadała konstrukcję zabezpieczającą przed nadmiernym gromadzeniem kondensatu w obwodzie oddechowym oraz dren do podaży wody o dł. 1,2 m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr270

Pakiet nr 70: Poz. 1 Układ oddechowy

Czy komora nawilżacza ma być oznakowana datą ważności i numerem partii na opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w oznakowanie ale nie wymaga.

Pytanie nr271

PAKIET NR 88

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 88 pozycji nr 2 co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr272

PAKIET NR 88

Czy zamawiający dopuści również w Pakiecie nr 88 pozycja nr 2 błękit pakowany po 10 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr273

PAKIET NR 92

Czy zamawiający dopuści również retraktory jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polipropylenu oraz z silikonowego stopera, sterylne, pięć sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr274**PAKIET 95:**

Czy zamawiający dopuści również Roztwór Ryboflawiny w dekstranie T500 o objętości 1ml i stężeniu 0,1% w strzykawce, do zabiegów Cross-Linkingu z usunięciem nabłonka rogówki.

Roztwór nie zawierający lateksu.

Strzykawka szklana z końcówką Luer-Lock. Kaniula irygacyjna 25G wykonana ze stali ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr275

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 9 projektu umowy na:
„Wykonawca ponosi koszty transportu oraz dostarczenia Wyrobów medycznych do pomieszczeń magazynowych w siedzibie Zamawiającego.”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 9 ust. 2 umowy. Zamawiany towar musi być dostarczany do siedziby Zamawiającego przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach lub do lokalizacji przy ulicy Medyków 14 w Katowicach

Pytanie nr276

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust 12 wzoru umowy poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści: *„Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zamówień na min. 80% wartości umowy.”.*

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust. 12 umowy, który otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie nr277

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 1 na: *„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

- a) W wysokości 0,2% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej.*
- b) W wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy,*
- c) W wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za daną część zamówienia określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”*

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia w wyżej wskazany sposób zapisów § 5, ust. 1 umowy.

Pytanie nr278

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów §7 ust. 8 umowy

Pytanie nr279

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 62 w pozycji nr 1 jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace (Sontara) w gramaturze 68 g/m² z wewnętrznym laminatem PP+PE (polipropylen + polietylen) 40 g/m², zgodny z normą EN 13 795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru na fartuchu. Zapakowany wewnątrz w serwetę włókninową wraz z 2. wiskozowymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Pakowane po 50 sztuk najpierw w worek foliowy, potem w karton, rozmiary: M, L, XL, XXL

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr280

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 62 w pozycji nr 2 Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowego polietyleny i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, dobrze widocznej nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności, rozmiar XXL

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XXL	150cm	175cm	86cm

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr281

Pakiet 2

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do nebulizacji składającego się z nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μ m, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μ m) - 79,7%, parametry potwierdzone w badaniach producenta, z drenem ustnikiem i łącznikiem T, czysty mikrobiologicznie

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr282

Pakiet 2

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do nebulizacji składającego się z nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μ m, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μ m) - 79,7%, parametry potwierdzone w badaniach producenta, z maską i drenem o przekroju gwiazdkowym, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr283

Pakiet 2

Pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dren tlenowy do zestawu z nebulizatorem posiadał dedykowane, sztywne, standardowe złącze kodowane kolorystycznie barwą podstawki dyfuzora?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr284

Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie drenów długości 750 mm z perforacją na długości w min. 8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr285

Pakiet 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy zaoferowane dreny mają posiadać linię rtg na całej długości, oraz wyraźne czynniki głębokości?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr286

Pakiet 5

Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane dreny mają posiadać perforację z otworami o różnej wielkości, ułatwiające utrzymanie stałej siły ssania na całej długości perforacji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr287

Pakiet 15

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie łącznika karbowanego „martwa przestrzeń” ze złączami 22M/15F-15M, na opakowaniu jednostkowym nazwa, numer katalogowy, data ważności pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr288

Pakiet 15

Pozycja 1

Czy zamawiający ma na myśli łącznik „przestrzeń martwą” wykonany z medycznego PCV niezawierającego ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr289

Pakiet 15

Pozycja 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski tlenowej do podawania tlenu dla dorosłych z drenem oraz wążów tlenowych dla dorosłych pozbawionych lateksu i DEHP oraz zakończonych łącznikiem uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr290

Pakiet 15

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wążów tlenowych dla dorosłych z końcówkami donosowymi powodujących rozproszenie tlenu podczas tlenoterapii nie powodującymi traumatyzacji śluzówki.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr291

Pakiet 16 pozycja 1 i 2,3

W związku z wejściem w 2008 r. w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of medical devices - polskiej normy PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych, prosimy o odstąpienie od wymogu fabrycznie nadrukowanej informacji braku DEHP? W świetle tej zmiany producent ma obowiązek oznakowania wyrobu w przypadku gdy wyrób zawiera szkodliwe substancje. Jeśli takiego oznakowania nie ma, to znaczy, że wyrób ten nie zawiera substancji np. takich jak latex , PCV czy DEHP?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr292

Pakiet 12

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania klinicznego: maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, przyjmującej ukształtowanie zgodne z anatomicznym ułożeniem gardła, z całkowicie przezroczystym mankietem i rurką oddechową, tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co zapobiega zagięciu mankieta podczas zakładania. Znacznik pozycjonowania czarna linia kontrolująca prawidłowe usytuowanie maski. Dren do napełniania mankieta zakończony standardowym balonikiem kontrolnym umożliwiającym rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjnie dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankieta. Dodatkowo rozmiar maski kodowany kolorem mankieta. Rozmiary wg. wagi: od 30kg do 50kg, od 50kg do 70kg, od 70kg do 100kg, Rozmiary: 3, 4, 5 do każdorazowego wskazywania przez Zamawiającego w zamówieniu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr293

Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr294

Pakiet 13

Czy materiały użyte do konstrukcji maski mają umożliwiać jej użycie w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr295

Pakiet 13

Czy maska ma nie zawierać szkodliwego ftalanu DEHP ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr296

Pakiet 55

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie rozwiązania w postaci: modułowego zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych składającego się z pakowanych oddzielnie: sterylnego cewnika do użytku na 72 godziny do rurek intubacyjnych 14 i 16 CH o długości 54 cm i do rurek tracheostomijnych 12 i 14 CH o długości 34 cm oraz z czystego, gotowego do użycia podwójnie obrotowego adaptera (łącznika) do dróg oddechowych o poziomie czystości mikrobiologicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, łącznik o kącie 45 stopni, z możliwością wymiany cewnika, z samodomykającą się dwudzielną zastawką komory płuczącej, z obrotowym, zamykanym portem do przepłukiwania cewnika oraz z możliwością podania leków w formie płynnej oraz z możliwością wykonania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Końcówka cewnika z dwoma otworami bocznymi.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr297

Pakiet 55

Pozycja 1

Z uwagi na fakt, iż oferowany system modułowy składa się z adaptera (łącznika) do dróg oddechowych o czasie stosowania tak jak obwód oddechowy do 7 dni i jako taki może "obsłużyć" 2 cewniki o czasie stosowania do 72 godzin, prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny 380 cewników oraz 190 adapterów (łączników) do dróg oddechowych. Takie rozwiązanie jest klinicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystnej i konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr298

Pakiet 55

Pozycja 1

Czy wszystkie elementy zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych mają być pozbawione szkodliwego ftalanu DEHP ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr299

Pakiet 55

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system do odsysania ma umożliwiać wykonanie rutynowych procedur w oddziale OIT tj. np. procedury bronchofiberoskopii, procedury pobierania aspiratu z dróg oddechowych - mini-BAL bez potrzeby rozłączania systemu od rurki intubacyjnej (czyli bez utraty idei oraz istoty zamkniętego systemu do odsysania z dróg oddechowych) i związanych z tym zagrożeń epidemiologicznych w postaci zwiększonego ryzyka zakażeń krzyżowych oraz utraty założonych parametrów oddechowych - w tym spadku dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego - PEEP (Positive End-Expiratory Pressure)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr300

Pakiet 55

Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania - zestawu do drenów ssania, składającego się z łącznika Y o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) oraz dwa końce męskie, pozwalającego na podłączenie do jednego źródła próżni dwóch drenów ssania oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiającej zamknięcia końca drenu nie podłączonego do cewnika do odsysania w systemie zamkniętym – jak na rysunku poniżej



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr301

Pakiet 21

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie pojemności 650 ml

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr302

Pakiet 21

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pojemności 340 ml

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr303

Pakiet 33 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowany worek ma posiadać bezigłowy port do pobierania próbek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr304

Pakiet 33 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowany worek ma umożliwiać pobór moczu przez bezigłowy port w drenie, który powinien być obły bez ostrych krawędzi i rowków?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr305

Pakiet 33 pozycja 2

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia trwałości worka, wymaga się aby worek posiadał podwójny zgrzew?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr306

Pakiet 48

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtra oddechowego wirusowo- bakteriobójczego z wkładem hydrofobowym cechującego się niską opornością, o efektywności filtracji bakterii 99,9999% i wirusów 99,999, przestrzeni martwej lepszej (mniejszej) 26 ml, objętości pływowej 150-1000 ml, port kapno zamknięty koreczkiem luer lock.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr307

Pakiet 48

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtra oddechowego wirusowo- bakteriobójczego z wkładem hydrofobowym cechującego się niską opornością, o efektywności filtracji bakterii 99,9999% i wirusów 99,999, przestrzeni martwej lepszej (mniejszej) 35 ml, wadze 31 g, objętości pływowej 150-1000 ml, port kapno zamknięty koreczkiem luer lock.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr308

Pakiet 48

Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie sterylnego nawilzacza typu sztuczny nos z dwoma filtrami z możliwością podłączenia tlenu, standardowe wyjście 15F, dwie celulozowe części filtrujące, wyjście do odsysania z samodomykającą się membraną , która może być otwarta podczas odsysania bez konieczności odłączania filtra od rurki.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr309

Pakiet 14

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego, czystego biologicznie obwodu oddechowego do respiratora, 22 mm, wykonanego z polietylenu, karbowanego z odłączalnym trójnikiem Y z portem kapno, odłączalnym podwójnie obrotowym kolankiem, obwód o długości 150 cm.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr310

Pakiet 14

Pozycja 1

W przypadku braku dopuszczenia prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr311

Pakiet 14

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie: obwód oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy o długości 1,8 m, złącze kątowe z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,45 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, łącznik prosty 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr312

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z drenem 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr313

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kraniki trójdrożne z dren 7 i 25 cm mają być wyposażone w dodatkowy port do iniekcji (wstrzyknięć)

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr314

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kraniki mają być wyposażone w białe trójramiennie pokrętło i dren bez zawartości DEHP

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr315

Pakiet 19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone białe trójramiennie pokrętło oraz w kolorowe znaczniki do oznaczania linii żylniej (niebieski) i tętniczej (czerwony)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr316

Pakiet 98

Pozycja 1,-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do grawitacyjnego podawania leków z dwoma zaworami bezigłowymi (z dezynfekowalną membrana) bez zaworu jednokierunkowego, długość zestawu 195 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr317

Pakiet 98

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii przezroczystej z zaworem SmarSite i filtrem 0,2 mikrona?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr318

Pakiet 98

Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 7 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr319

Pakiet 98

Pozycja 7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra (2 skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-300 ml/h 10 %, , 5 -200 ml - 40 %), z zastawką antyzwrotną , zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą łatwe i bezpieczne wypełnienie i odpowietrzenie zestawu bez ryzyka skażenia, komora kroplowa i dren przezroczysty bez DEHP, bez lateksu, długość zestawu 220 cm, zacisk na drenie , sterylno-EO, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr320

Pakiet 16.

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z dwukanałową igłą biorczą bez kryzy ograniczającej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr321

Pakiet 16.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z z komorą kroplową z filtrem 200 µm, zaciskiem rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, długość zestawu 192 cm, sterylny - EO, z igłą biorczą jednokanałową, bez odpowietrzenia, z łącznikiem męskim typu Luer, pakowany w papier-folia, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, kod kreskowy, data ważności

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr322

Pakiet 86

Pozycja 2

Czy zamawiający oczekuje w poz 2. Przyrządu typu Spike z kolcem mikro, który umożliwi pobranie maksymalnej ilości leku ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr323

Pakiet 86

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu Spike z wbudowanym samouszczelniającym się i samodomykającym się zaworem bezigłowym, który zabezpieczna przed wyciekaniem w pozycji odwróconej ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr324

Pakiet 86

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spike do pobierania i przygotowania leków z samozamykającym się zaworem bezigłowym z silikonową membraną, do wielokrotnego użycia – do 100 aktywacji lub 72 h (przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji) ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr325

Pakiet 100

Pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu funkcjonalnie równoważnego do opisanego wg SIWZ wg poniższej charakterystyki: Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z silikonu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez min. 48 godzin przy nominalnej prędkości przepływu 5 ml/h w systemie zamkniętym. Wyposażony w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik oraz filtr odpowietrzający linię na przebiegu linii. Elementy mające kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fal od 300 do 450 nm (ze skutecznością większą niż 99,98%, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w obudowę wyposażony w połączenie luer lock. System infuzyjny stabilny z 5-FU. Pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futeła. Wyrób medyczny klasy IIB. Objętość nominalna 275 ml, maksymalnie 330 ml. Wymagana dokładność dostarczenia żądanej objętości w zakresie +/-15% nominalnego czasu wlewu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr326

Pakiet 100

Pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu funkcjonalnie równoważnego do opisanego wg SIWZ wg poniższej charakterystyki: Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z silikonu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez min. 24 godzin przy nominalnej prędkości przepływu 10 ml/h w systemie zamkniętym. Wyposażony w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik oraz filtr odpowietrzający linię na przebiegu linii. Elementy mające kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fal od 300 do 450 nm (ze skutecznością większą niż 99,98%, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w obudowę wyposażony w połączenie luer lock. System infuzyjny stabilny z 5-FU. Pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futeła. Wyrób medyczny klasy IIB. Objętość nominalna 275 ml, maksymalnie 330 ml. Wymagana dokładność dostarczenia żądanej objętości w zakresie +/-15% nominalnego czasu wlewu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr327

Pytania dot. asortymentu:

Zad.56: Czy Zamawiający dopuści zestaw noworodkowy o składzie:

- serweta przylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego(polipropylen/polietylen) o gram. 43 g/m2 w rozmiarze 90x75 cm - 1 szt
- ręczniki do rąk 20x40 cm wykonane z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m2 - 4 szt
- czapeczka dla noworodka - 1 szt
- podkład z pulpą celulozową typu Seni Soft 60x90 cm - 1 szt
- kompresy gazowe 17n8w 7,5x7,5 cm - 10 szt
- tupfer kula wykonany z wykroju gazy 17n 50x50 cm - 10 szt
- kocyk flanelowy w motywy dziecięce 160x75 cm - 1 szt
- klem do pępowiny - 1 szt
- jednorazowy centymetr do mierzenia noworodka - 1 cm
- fartuch chirurgiczny,jednorazowy pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi w

części przedniej i przedramionach o łącznej gramaturze 75g/m² fartuch złożony w sposób zapewniający antyseptyczną aplikację, wiązany na troki, z tyłu zapięcie na rzep, indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, rozmiar XL- 1 szt
- fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki z tyłu zapięcie na rzep, indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, rozmiar fartucha XL - 1 szt
- serweta na stół instrumentalny 150x90 cm wykonana z laminatu polietylen i polipropylen o gramaturze 43g/m² na całej powierzchni serwety (owinięcie zestawu)- 1 szt

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr328

Pak.58: Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji o składzie:

- tupfer kula 20x20cm 5szt.
- kleszczyki typu korcang 19cm- 1 szt.
- miska plastikowa 150ml- 1szt.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr329

Pak.62 poz.3: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr330

Pak.62 poz.3: Czy Zamawiający dopuści ubrania w kolorze niebieskim i fioletowym o nieprzemakalności min.23 H₂O?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr331

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr332

Zważywszy na treść § 2 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można

zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 2, ust. 12 umowy, który otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie nr333

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnień” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający w § 5 ust. 1 lit. a) i b) umowy nie wyraża zgody aby słowa „opóźnień” zostały zastąpione słowami „zwłoki”

Pytanie nr334

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 5 ust. 1 lit. c) umowy w zaproponowany sposób.

Pytanie nr335

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 3 umowy.

Pytanie nr336**Dotyczy pakietu 13.**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowe maseczki twarzowe anestezyjologiczne o ergonomicznym kształcie zapewniające anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczki wyposażone w mankiet powietrzny z możliwością jego regulacji, za pomocą zaworu. Przezroczysty, elastyczny korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, maseczki dostępne w rozmiarach od 0 do 6 (0 – neonatologiczna - 6 - duży dorosły); w zakresie rozmiarów 4-6 wyposażone są dodatkowo w antypoślizgowe krawędzie, zapewniające wygodny uchwyt dla personelu. Materiał PCW i PC bez DEHP i lateksu. Maseczki wyposażone w elementy kodowane kolorystycznie, co ułatwia identyfikację rozmiaru maski.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr337**Dotyczy pakietu 15, poz. 1.**

Prosimy o dopuszczenie - Karbowane, wewnątrznie gładkie, mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o regulowanej długości 10 - 16 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopii. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP. Opakowanie foliowo – papierowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr338**Dotyczy pakietu 15, poz. 2.**

Prosimy o dopuszczenie - Zestaw tlenowy do prowadzenia terapii średnimi stężeniami tlenu, przeznaczony dla jednego pacjenta, składający się z anatomicznie wyprofilowanej maski twarzowej oraz drenu z PCV o długości 2,1 m, z możliwością jego odłączenia, ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. Korpus maski, usztywniony, wykonany z PP, wyposażony w 4 równomiernie rozłożone otwory, ułatwiające wydech, kołnierz maski wykonany z TPE, miękkiego, atraumatycznego materiału, uformowanego tak, aby zapewnić szczelne przyleganie, z uwzględnieniem trzech punktów podporowych twarzy. Zestawy dostępne w rozmiarze S oraz M/L

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr339**Dotyczy pakietu 70, poz. 8.**

Prosimy o informacje, czy ma być to łącznik z czujnikiem przepływu dla noworodków, czy czujnik przepływu typu spirológ. W przypadku łącznika z czujnikiem przepływu dla noworodków prosimy o wskazanie rodzaju – czy ma być to czujnik prosty, czy kątowy, kątowy prosty

Odpowiedź

Zamawiający w Pakiecie nr 70 w pozycji 8 wymaga czujnik przepływu typu spirológ

Pytanie nr340**Dotyczy pakietu 70, poz. 7.**

Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jakim jest opakowanie, zawierające 5 sztuk, prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowania – czyli 1 op.=5 sztuk lub 2 op. = 10 szt.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości sztuk. Zamawiający nie zmienia wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr341**Dotyczy pakietu 70, poz. 5.**

Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jakim jest opakowanie, zawierające 10 sztuk, prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowania – czyli 96 op.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości sztuk. Zamawiający nie zmienia wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr342**Dotyczy pakietu 70, poz. 4.**

Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jakim jest opakowanie, zawierające 5 sztuk, prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowania – czyli 192 op.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości sztuk. Zamawiający nie zmienia wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr343**Dotyczy pakietu 70, poz. 3.**

Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jakim jest opakowanie, zawierające 10 sztuk, prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowania – czyli 96 op.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości sztuk. Zamawiający nie zmienia wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr344**Dotyczy pakietu 70, poz. 2.**

Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jakim jest opakowanie, zawierające 20 sztuk, prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowania – czyli 50 op.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości sztuk. Zamawiający nie zmienia wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr345**Pakiet 2 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu jednorazowego użytku do nebulizacji z ustnikiem dla dorosłych/dzieci. Nebulizator do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora , pojemność nebulizatora 10 ml , skalowany co 2 ml, wielkość nebulizowanych cząstek 2-5 mikronów; zestaw z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,1m.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr346Pakiet 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu jednorazowego użytku do nebulizacji z maską dla dorosłych/dzieci. Maski pozbawiona ftalanów, z elastomerowym mankietem dopasowującym się do różnych wielkości twarzy, nebulizator do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora, pojemność nebulizatora 10 ml, skalowany co 2 ml, wielkość nebulizowanych cząstek 2-5 mikronów; zestaw z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,1m.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr347Pakiet 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej, jednorazowej, pozbawionej PVC (nie zawierającej szkodliwych ftalanów). Maski wykonana z dwóch różnych typów materiału. Odpowiednio sztywna kopuła posiada krystalicznie przezroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu. Wielkość maski kodowana kolorem kołnierza. Pakowana pojedynczo z numerem serii i datą ważności na produkcję. Maski mikrobiologicznie czyste, dostępne w sześciu rozmiarach.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr348Pakiet 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowej pozbawionej PCV (nie zawierającej szkodliwych ftalanów); Maski wykonana z dwóch różnych typów materiału. Odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiada krystalicznie przezroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu. Wielkość maski kodowana kolorem kołnierza, obejmująca dwa standardowe rozmiary. Dostępna w czterech rozmiarach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr349Pakiet 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego sterylne lub czystego biologicznie dla dorosłych do respiratora, 22mm wykonany z PVC o gładkim świetle wewnątrz, z odłączalnym trójnikiem Y z dwoma portami pomiarowymi lub zamiennie z portem MDI. Długość obwodu od 150-200cm, zatyczka do każdego zestawu zamykająca obwód.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr350**Pakiet 15 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie łącznika anestetycznego karbowanego, rozciągliwego z pamięcią kształtu; z polipropylenu ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze do rur w kierunku respiratora 22F, z podwójnym portem zatraskowym z uszczelnieniem (z portem do odsysania 7,6mm z portem do bronchoskopii 9,5mm) o długości 15cm, regulacja w zakresie od 7-15cm, sterylny. Na opakowaniu jednostkowym nadrukowany nr kat., data ważności.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr351**Pakiet 15 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie maski do podawania tlenu dla dorosłych, przezroczystej, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym, bez zacisków na nos i innych metalowych części wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) na wysokości nosa i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust; w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min.210 cm, produkt mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr352**Pakiet 15 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z prostymi końcówkami, część donosowa wykonana z miękkiego materiału, mikrobiologicznie czysty, z odpornym na zgniatanie niezłamującym się drenem o długości 210cm.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr353**Pakiet 48 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie filtru oddechowego antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji min.99,999%, waga 23g, przestrzeń martwa 42ml, opory przepływu 0,9 cm H₂O przy 30 l/min, 2,0. cm H₂O przy 60l/min z portem luer lock, minimalna objętość oddechowa 150ml, złącza 22F/15M-22M/15F.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr354**Pakiet 48 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie filtru antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, sterylny, elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji min.

99,999%, wydajność nawilżania 32 mg/l przy VT 500ml, waga 31g, przestrzeń martwa 57ml, opory przepływu 1,6 cm H₂O przy 30 l/min, 3,0. cm H₂O przy 60l/min z portem luer lock, minimalna objętość oddechowa 150ml, złącza 22F/15M-22M/15F.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr355

Pakiet 48 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do tracheostomii z portem tlenowym zgodnym z ISO i do odsysania o poniższych parametrach: zwrot wilgoci 26mg H₂O/L, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa 50ml, opór przy 30L/min 0,2cm H₂O, opór przy 60L/min 0,7 cm/H₂O, sterylne.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr356

Pakiet 110 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej, jednorazowej, z PCV, przezroczystej z drenem wbudowanym w rurkę na 2/3 jej długości. Rozmiary od 1,0 do 5.0 wskazane każdorazowo w zamówieniu

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr357

Pakiet 110 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych dla dzieci z drenem, o dł. 210 cm; maska wykonana z miękkiego medycznego przezroczystego polipropylenu z elastomerowym mankietem dopasowującego się do anatomicznej budowy twarzy. Maski te są o 50% lżejsze niż tradycyjne maski z PCV, dzięki temu wygodniejsze dla pacjenta, bez metalowej klamry, bowiem zagięty szczelnie mankiet nosowy eliminuje konieczność stosowania metalowej blaszki i skutecznie zapobiega przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, jednocześnie można taką maskę bezpiecznie stosować w środowisku MRI, maska pozbawiona jest ftalanów, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr358

Pakiet 110 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie maski do tlenoterapii dla dorosłych, przezroczystej, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym, bez zacisków na nos i innych metalowych części wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) na wysokości nosa i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust, w komplecie

dren o przekroju gwiazdkowym min.210 cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo folia-folia.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr359

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 122 poz. 1 aparatu biopsyjnego wyposażonego w jeden spust tylny. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr360

Dot. Pakiet nr 43

Proszę o doprecyzowanie danych dotyczących typu oraz pojemności pasty do mocowania elektrod, jaką należy zaoferować w ww. pakiecie , w pozycji nr 1.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pasty do mocowania elektrod EE9 o pojemności 228g, stosowaną na skórę.

Pytanie nr361

Dot. Pakiet nr 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który w pakiecie nr 43 zaoferuje wysokiej jakości jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe 37 x 0,46 mm (26G) z połączonym złączem koncentrycznym rejestrującym odpowiedzi bez artefaktów i zapewniające komfort pacjentowi?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr362

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową o anatomicznie wygiętym kształcie ok 70stopni(ok 110 stopni w zależności od pozycji mierzenia kąta), przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga,

Pytanie nr363

Pakiet 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy z dwoma portami: do pomiaru ciśnienia i temperatury przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga,

Pytanie nr364

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczuleń zakończony kolankiem z łącznikiem kątowym 90 stopni dającym włożyć się w dowolnej pozycji, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Lub

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 3 rur rozciągliwych w zakresie ok.60- 180 cm, zakończony kolankiem z łącznikiem kątowym 90 stopni dającym włożyć się w dowolnej pozycji, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga,

Pytanie nr365

(pakiet nr 118, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do dróg łzowych prostą- 25G?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Z upoważnienia D Y R E K T O R A
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rehowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

08.06.2017r.